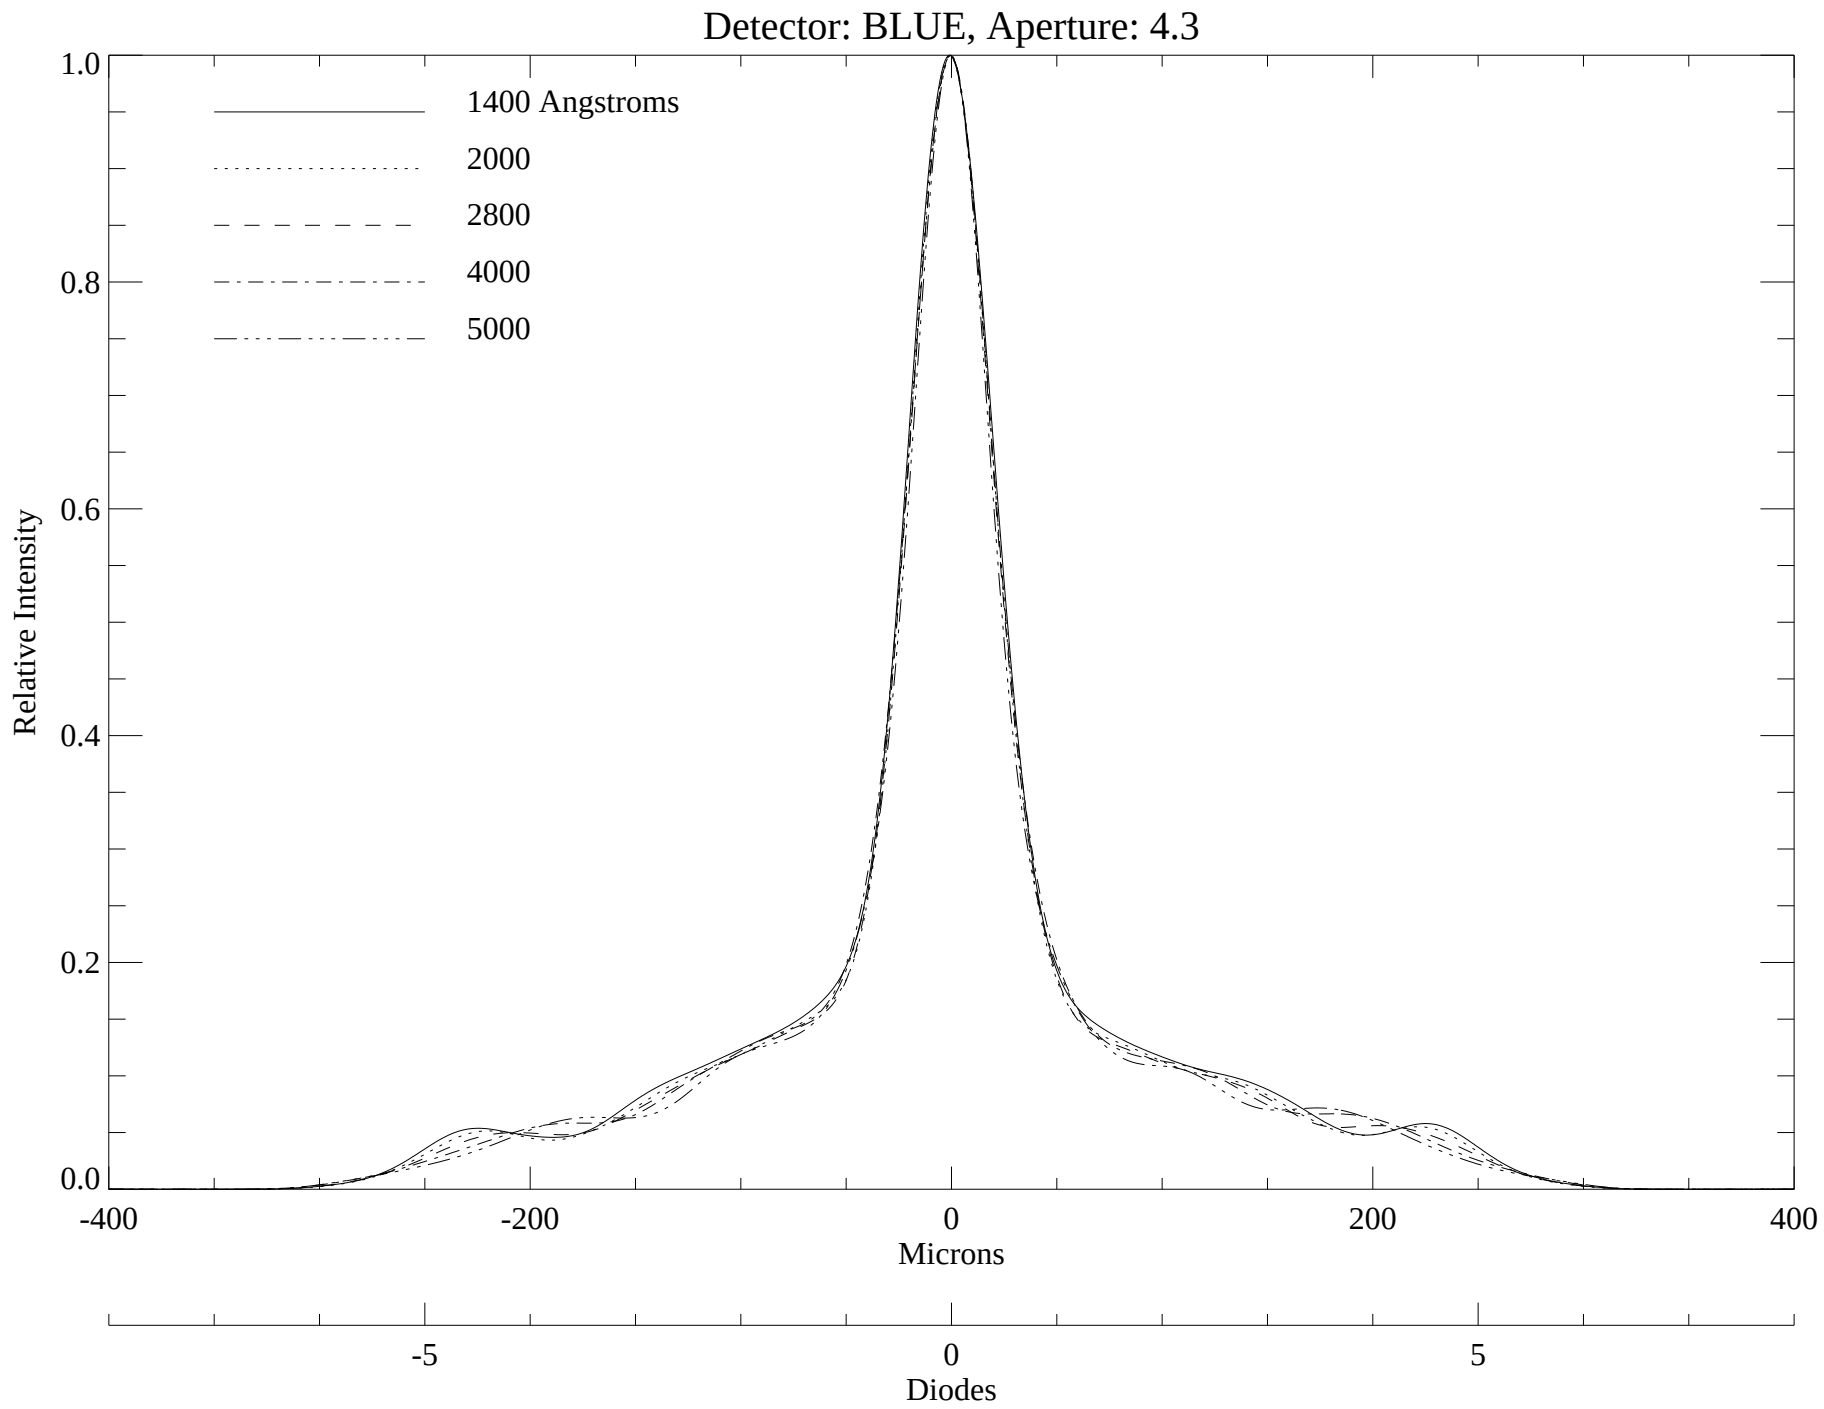
Detector: BLUE, Aperture: 4.3
1400 Angstroms
2000
2800
4000
5000
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-400
-200
0
200
400
Microns
-5
0
5
Diodes

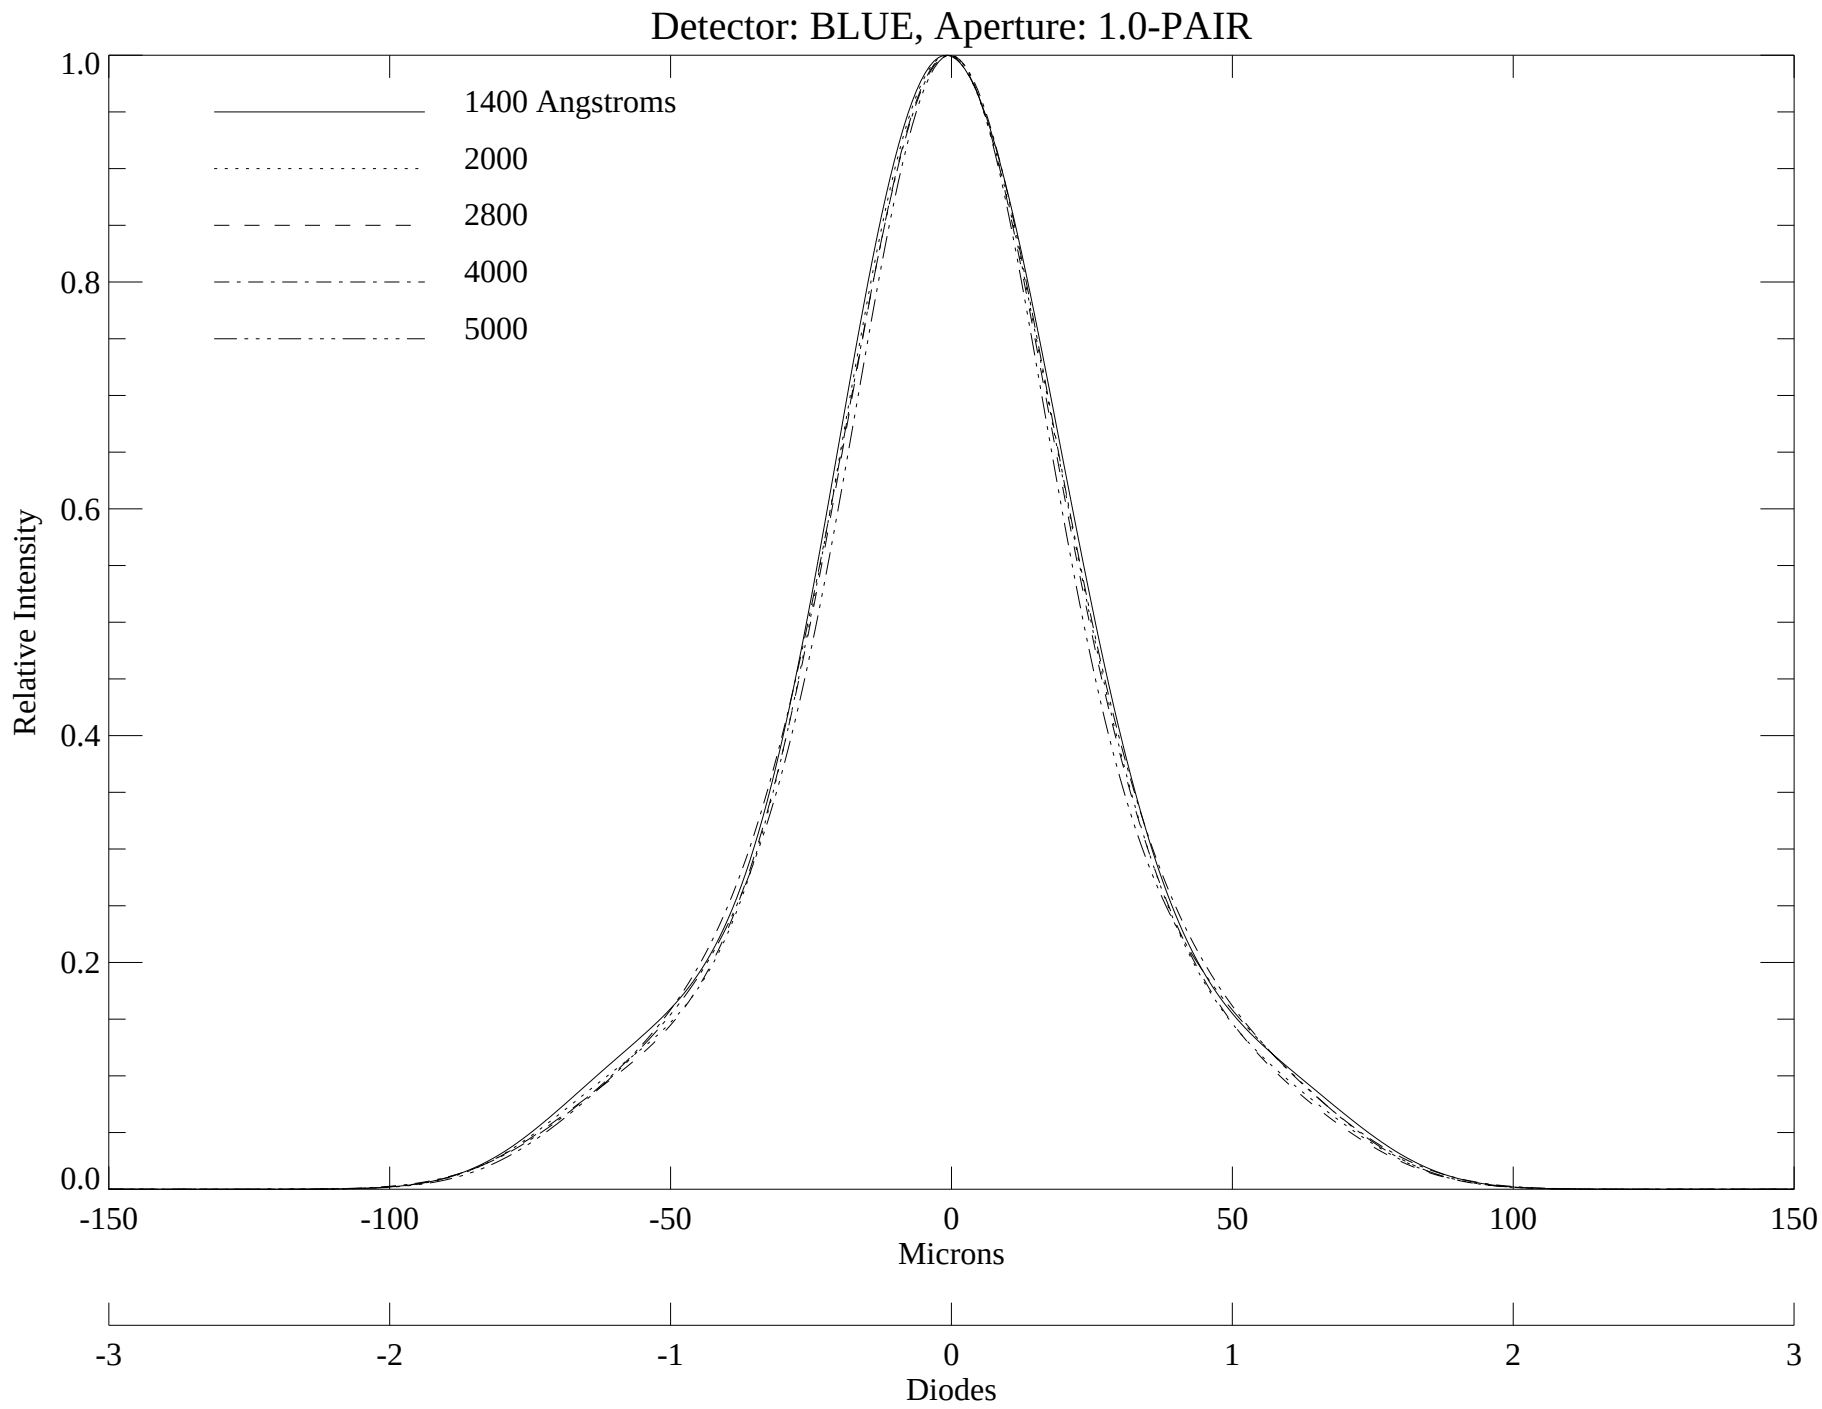
Detector: BLUE, Aperture: 1.0-PAIR
1400 Angstroms
2000
2800
4000
5000
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-150
-100
-50
0
50
100
150
Microns
-3
-2
-1
0
1
2
3
Diodes

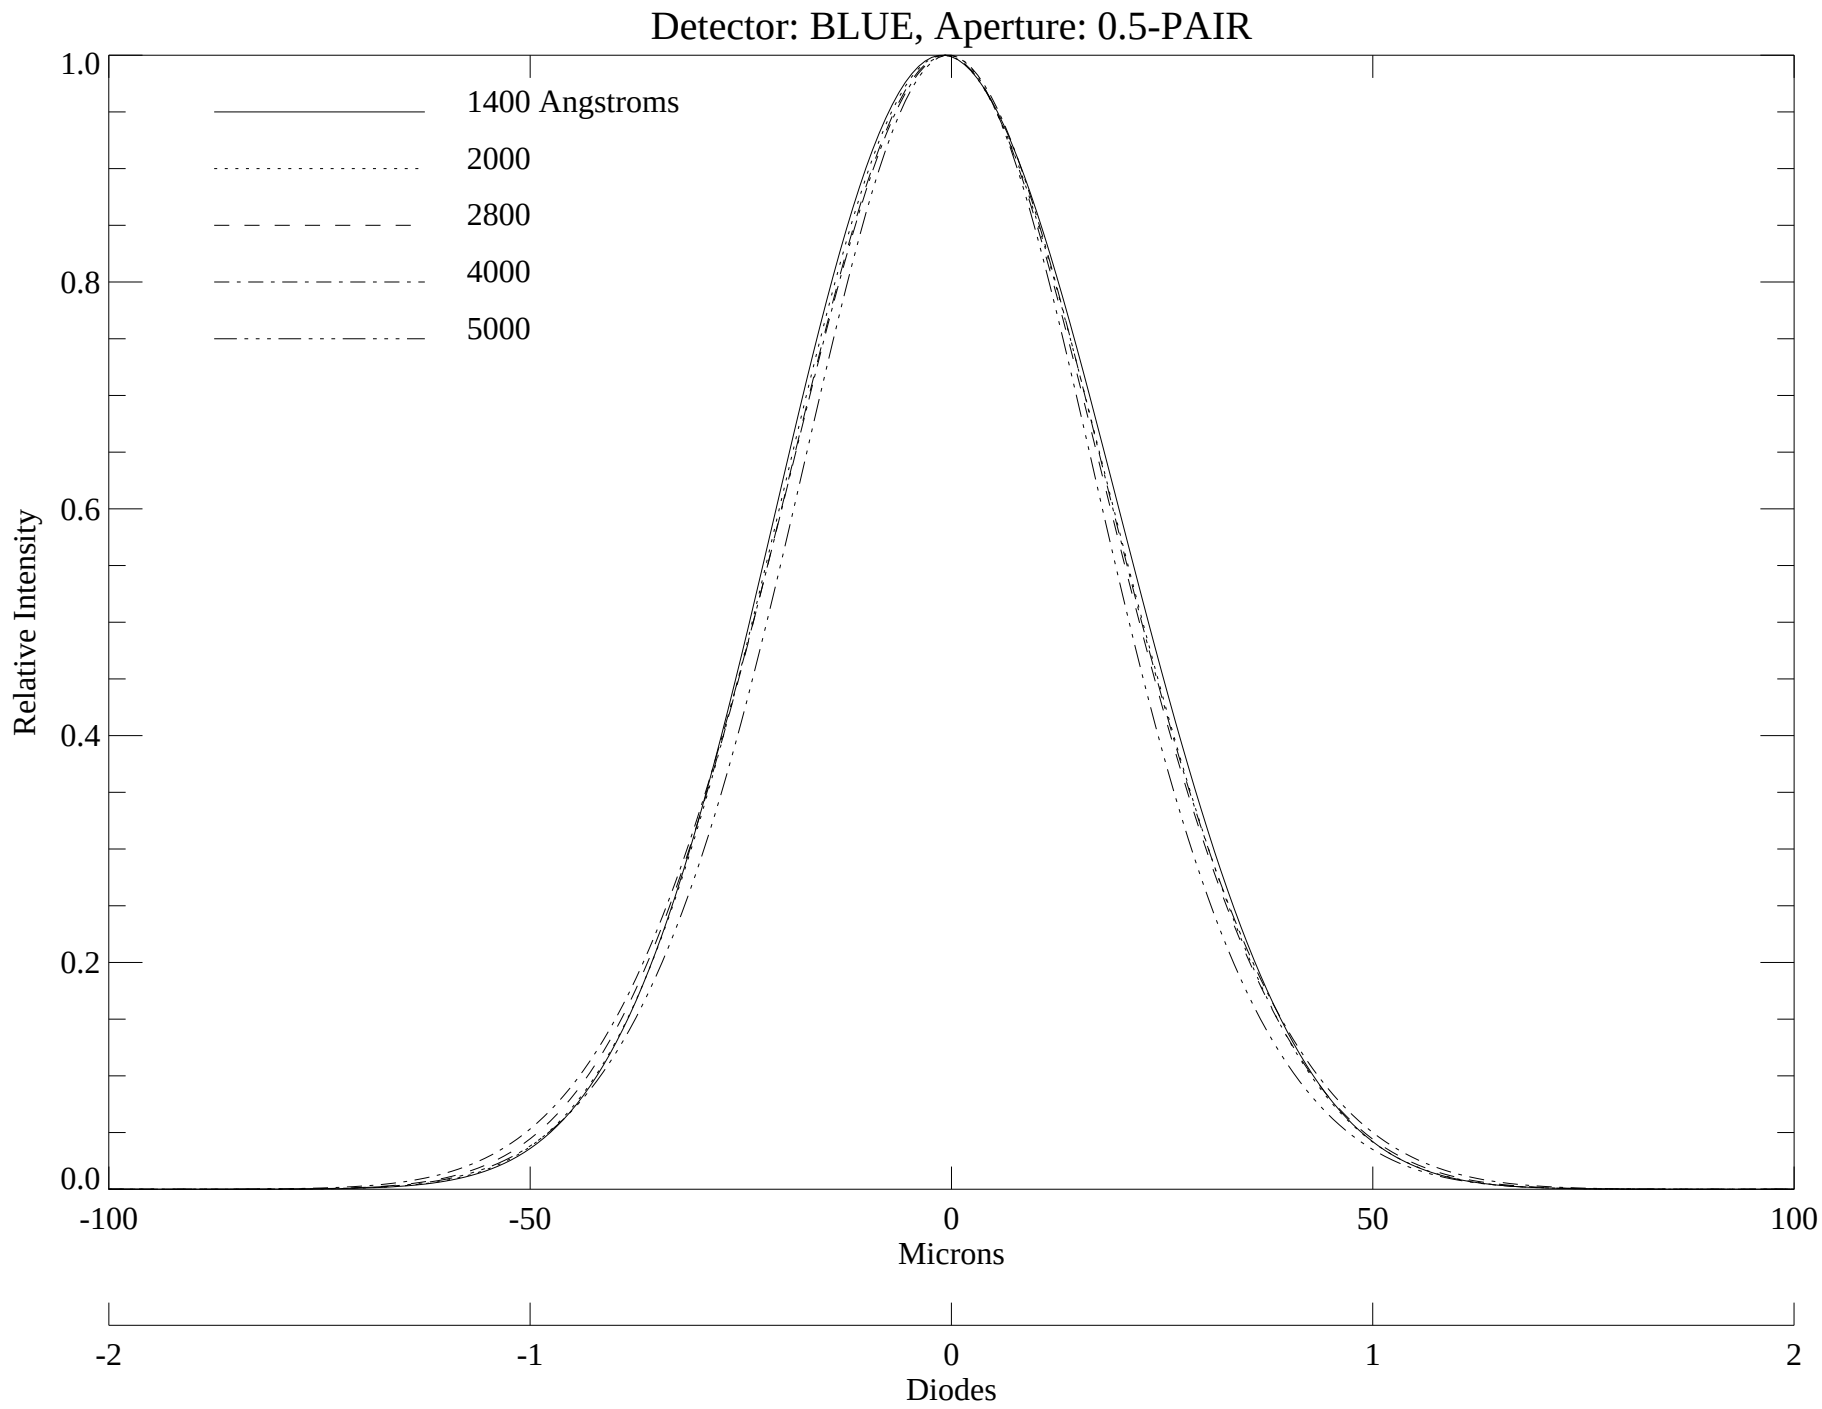
Detector: BLUE, Aperture: 0.5-PAIR
1400 Angstroms
2000
2800
4000
5000
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-100
-50
0
50
100
Microns
-2
-1
0
1
2
Diodes

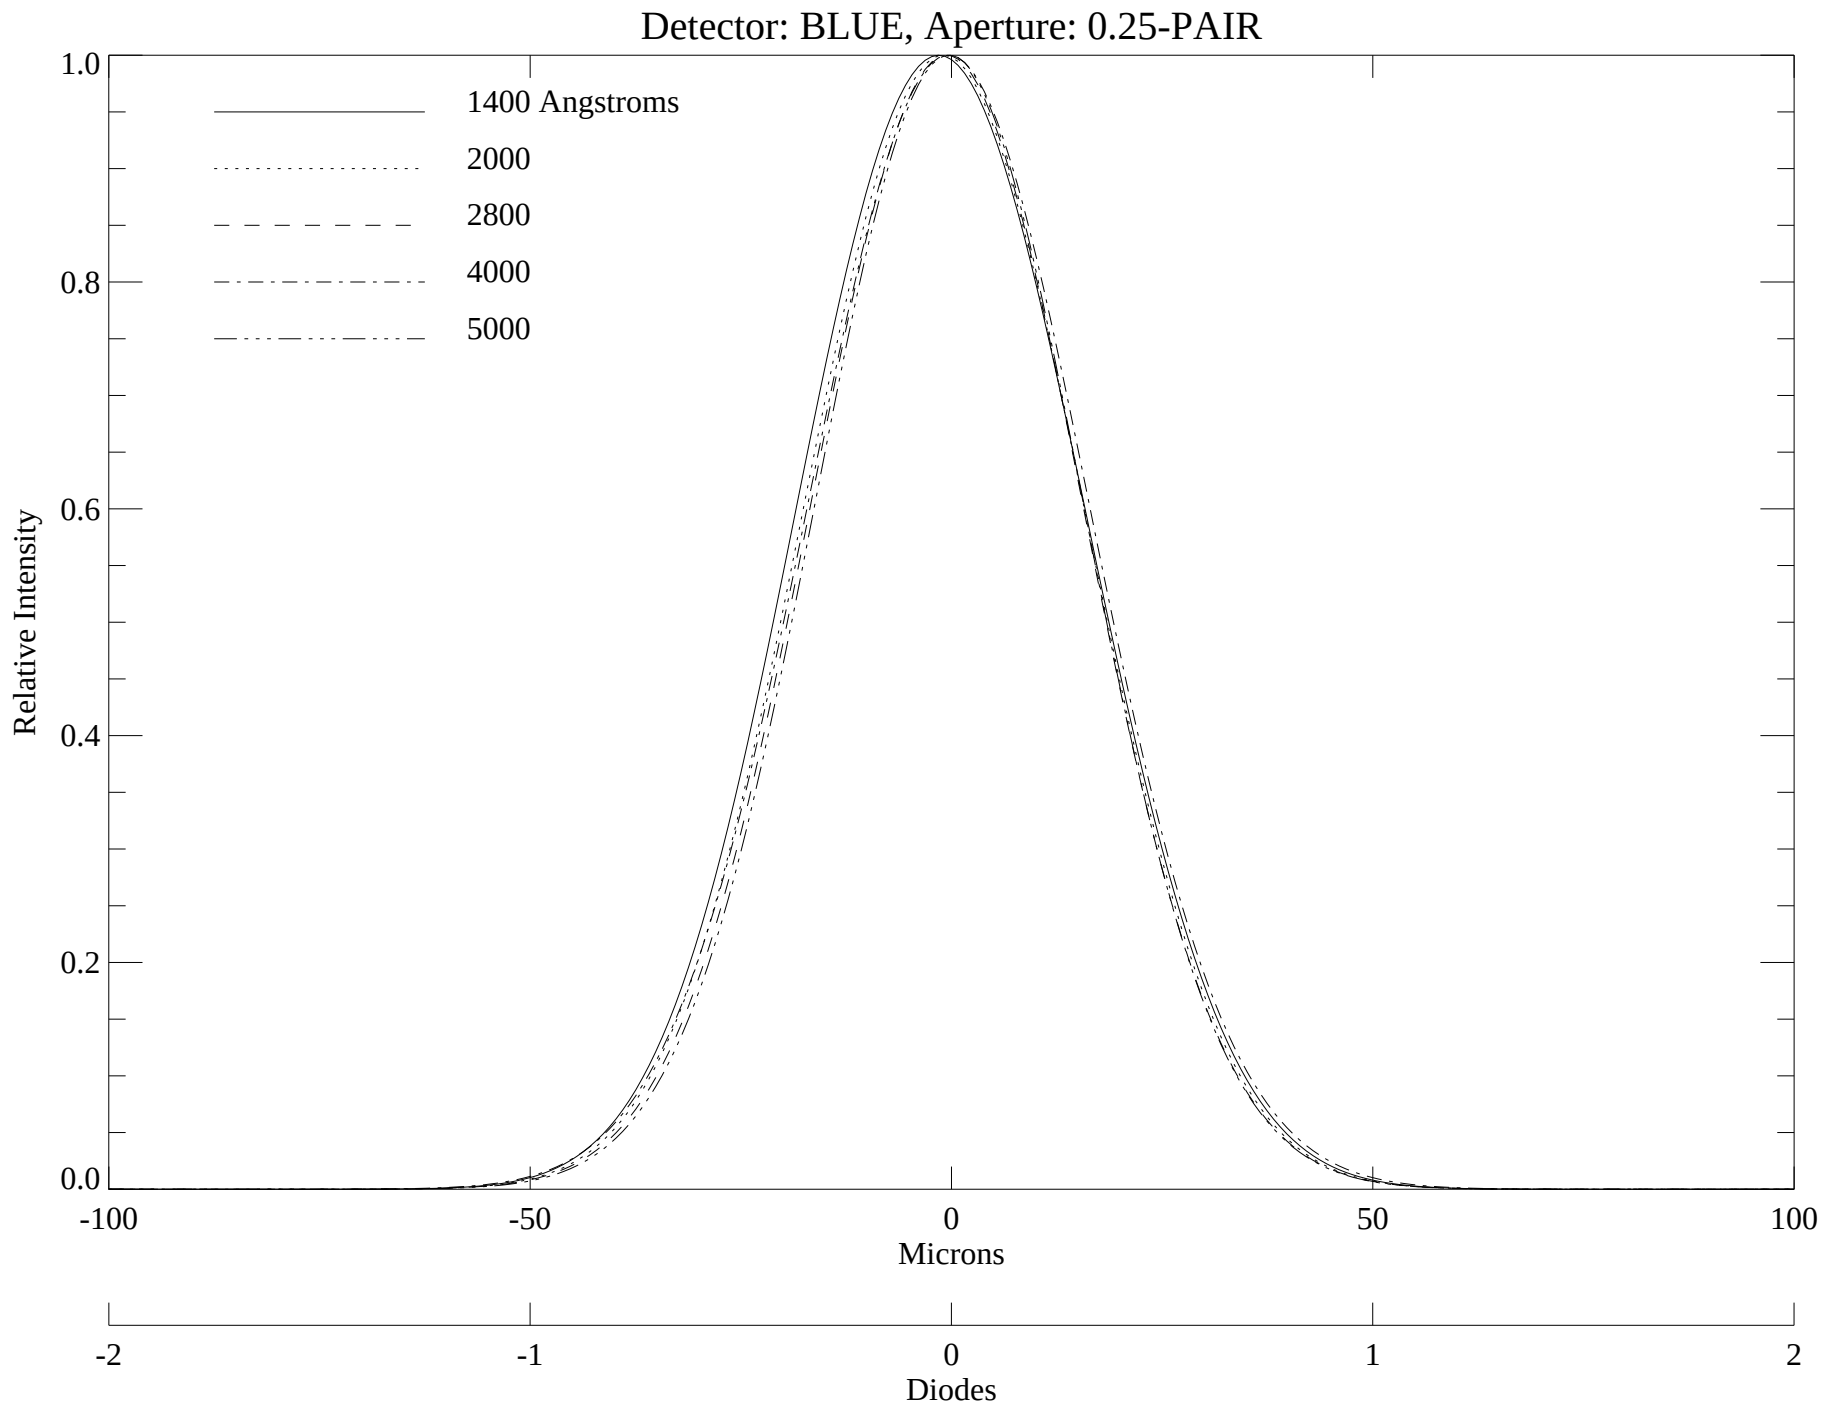
Detector: BLUE, Aperture: 0.25-PAIR
1400 Angstroms
2000
2800
4000
5000
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-100
-50
0
50
100
Microns
-2
-1
0
1
2
Diodes

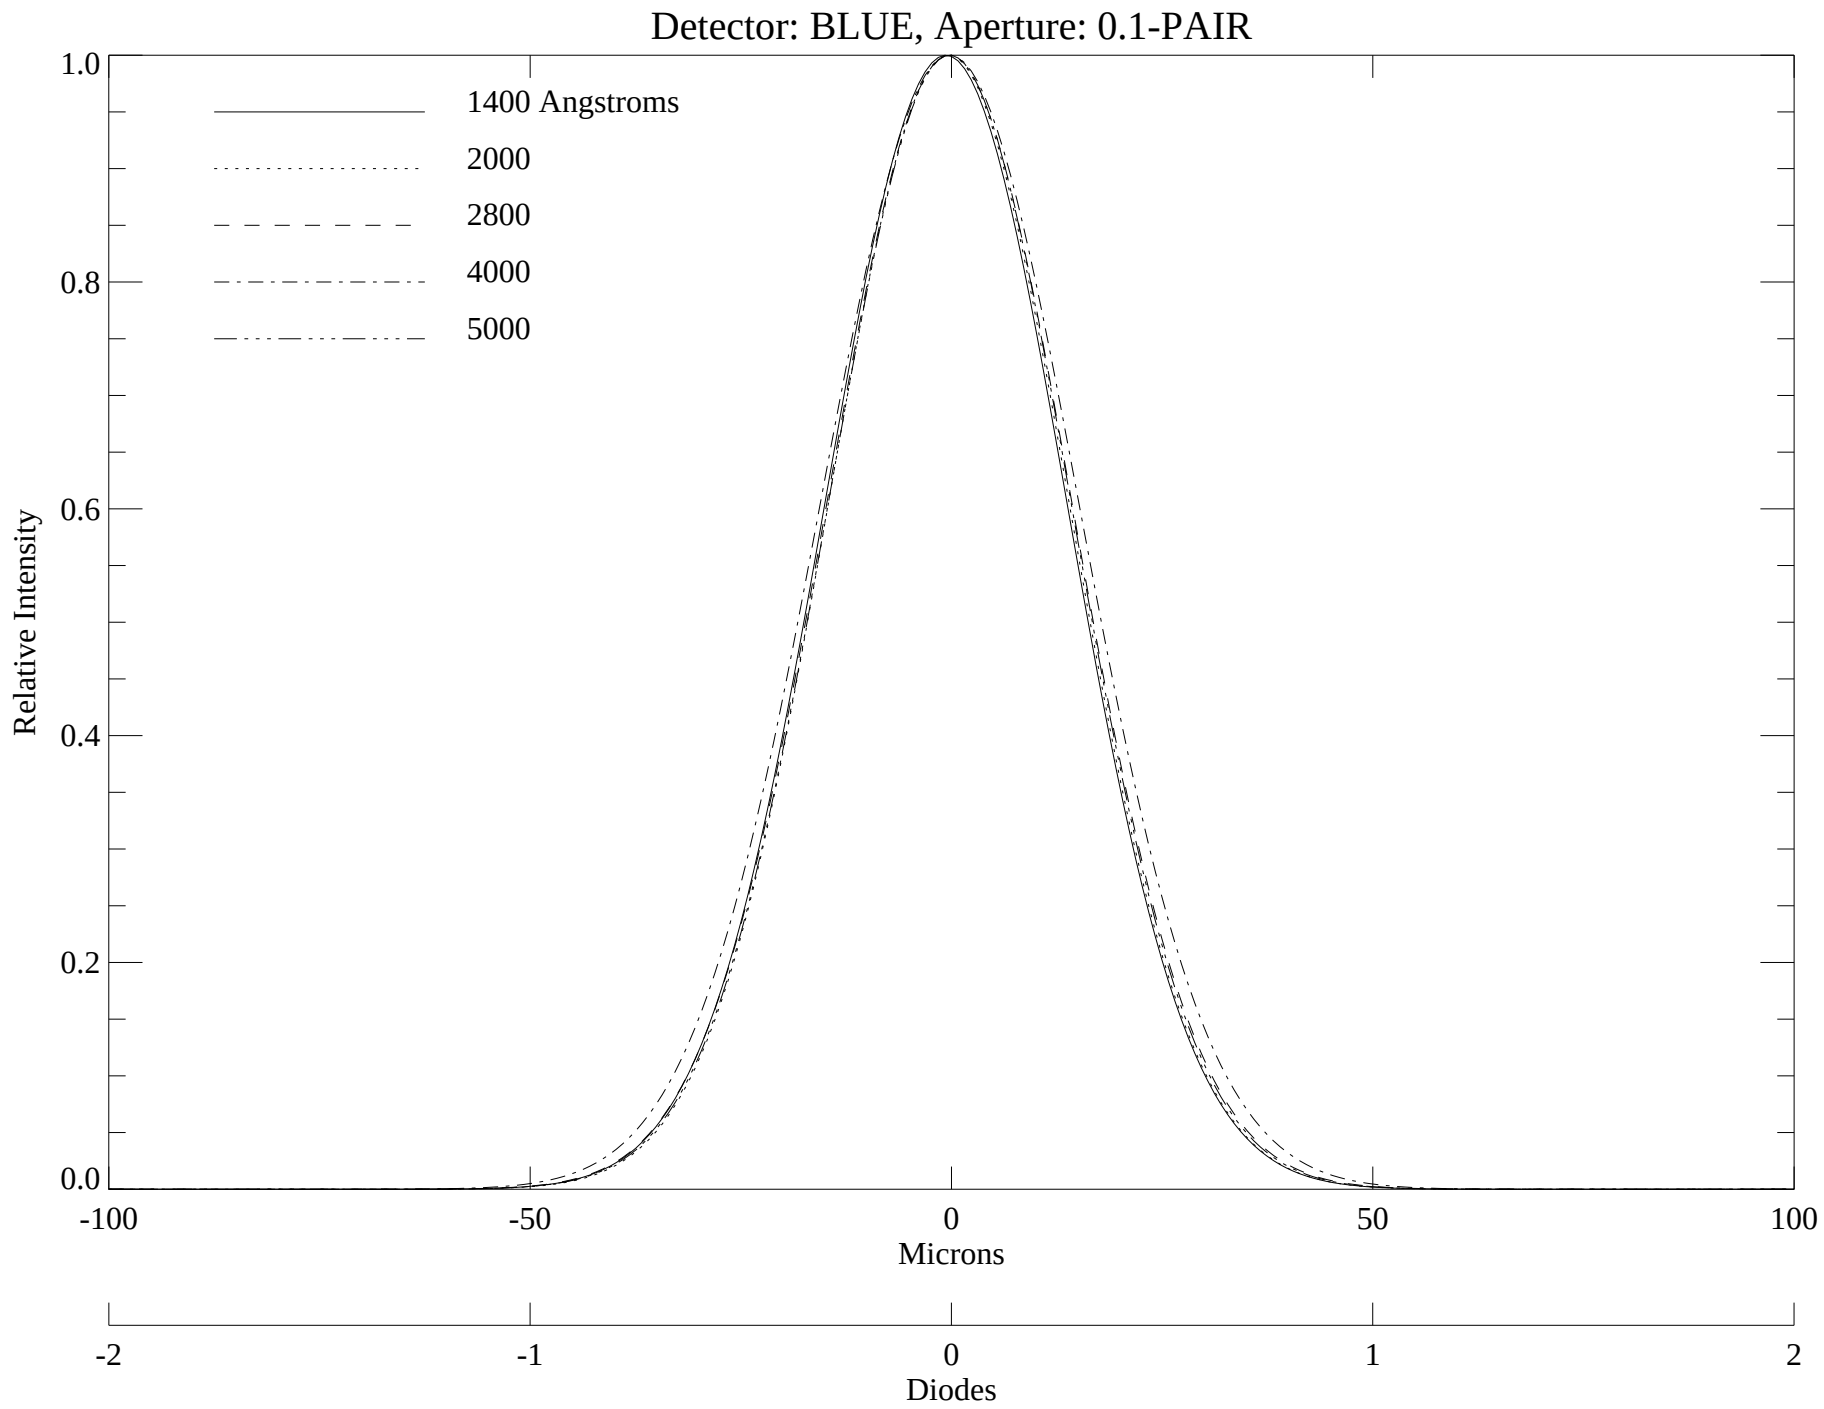
Detector: BLUE, Aperture: 0.1-PAIR
1400 Angstroms
2000
2800
4000
5000
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-100
-50
0
50
100
Microns
-2
-1
0
1
2
Diodes

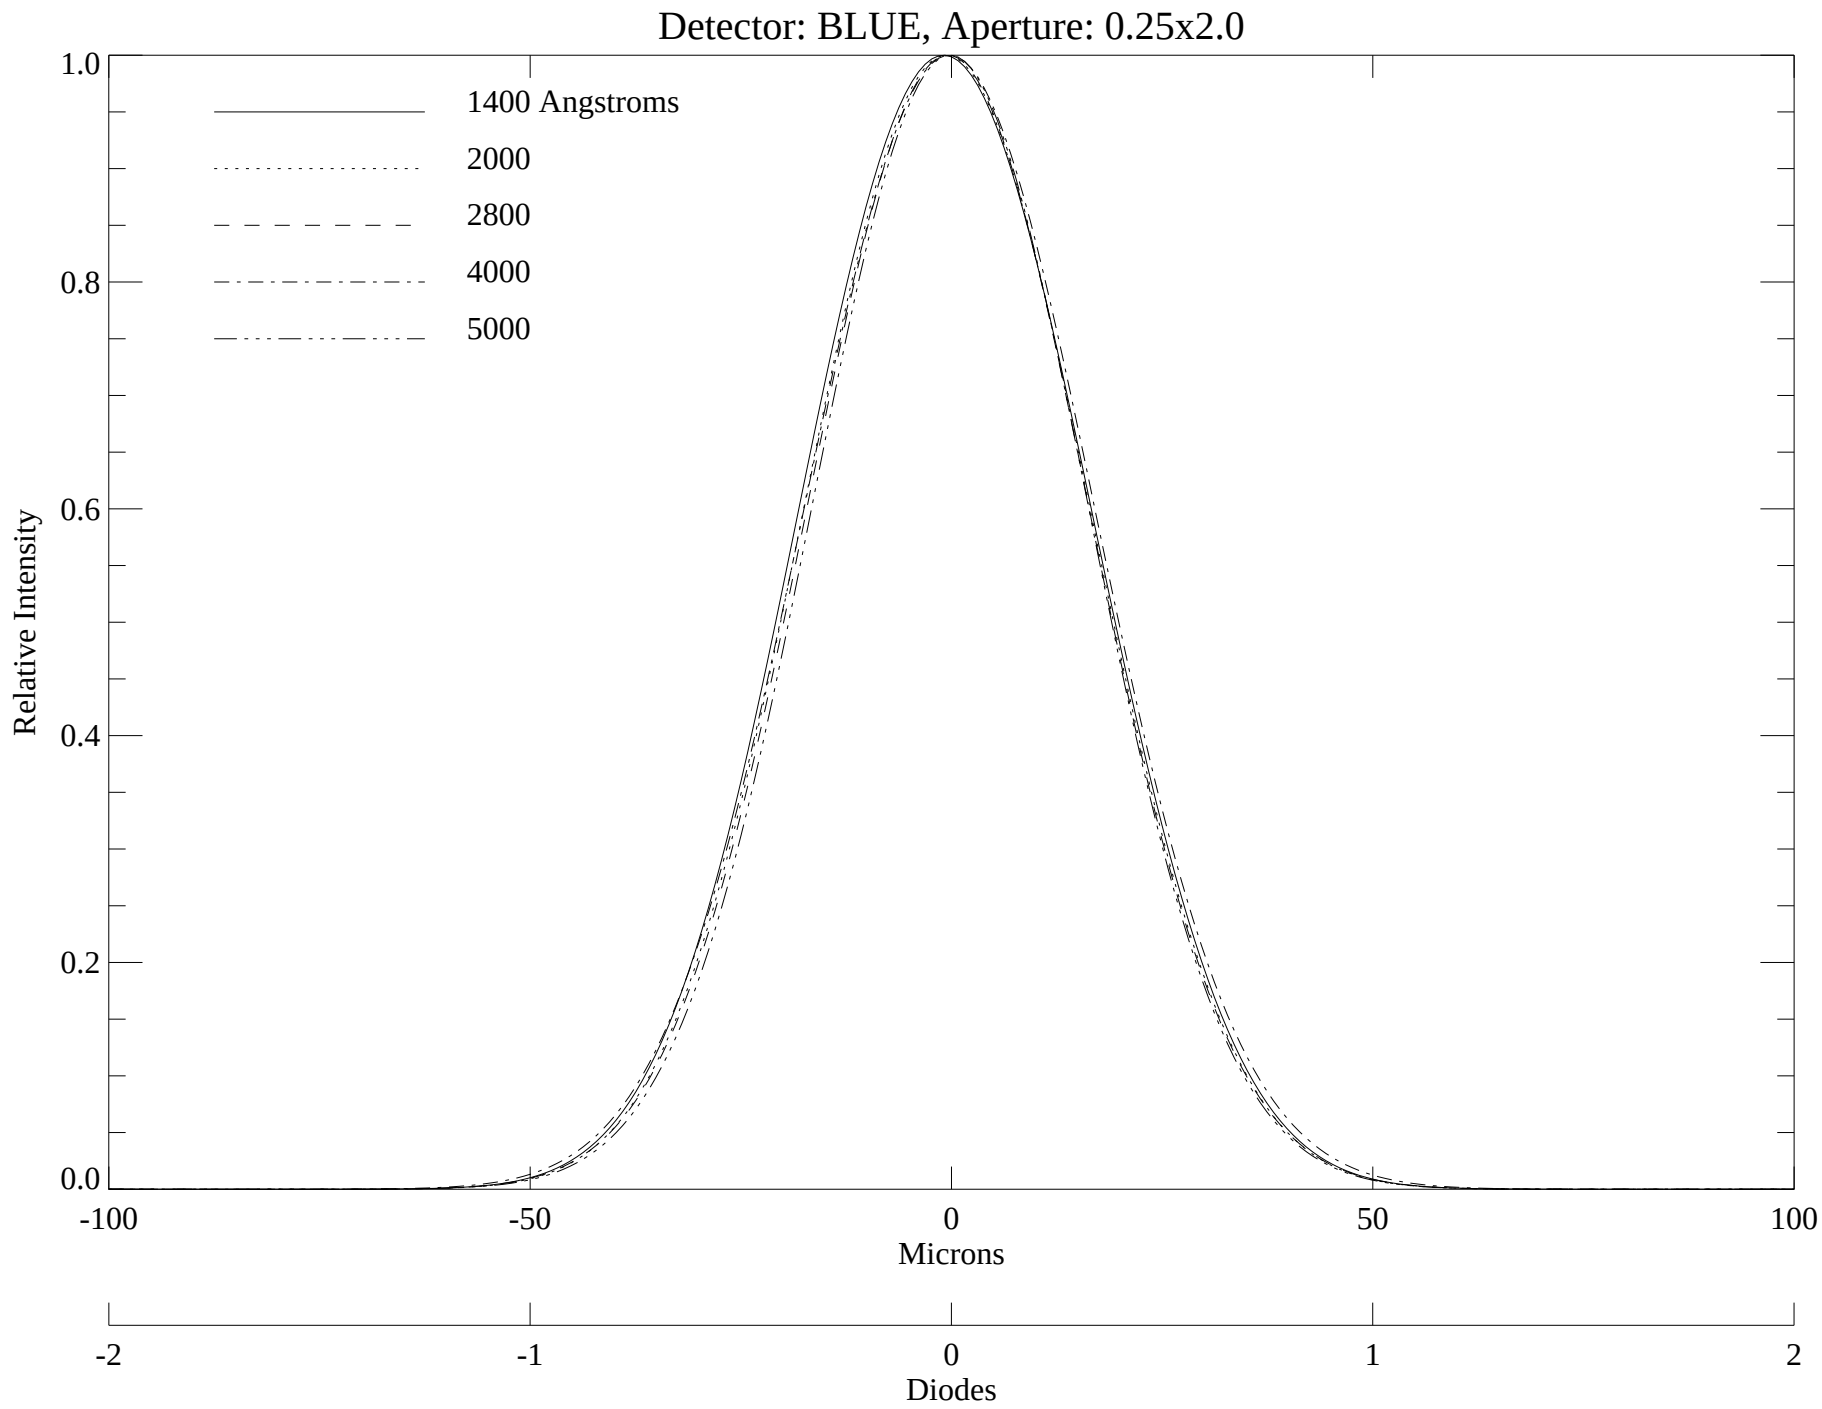
Detector: BLUE, Aperture: 0.25x2.0
1400 Angstroms
2000
2800
4000
5000
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-100
-50
0
50
100
Microns
-2
-1
0
1
2
Diodes

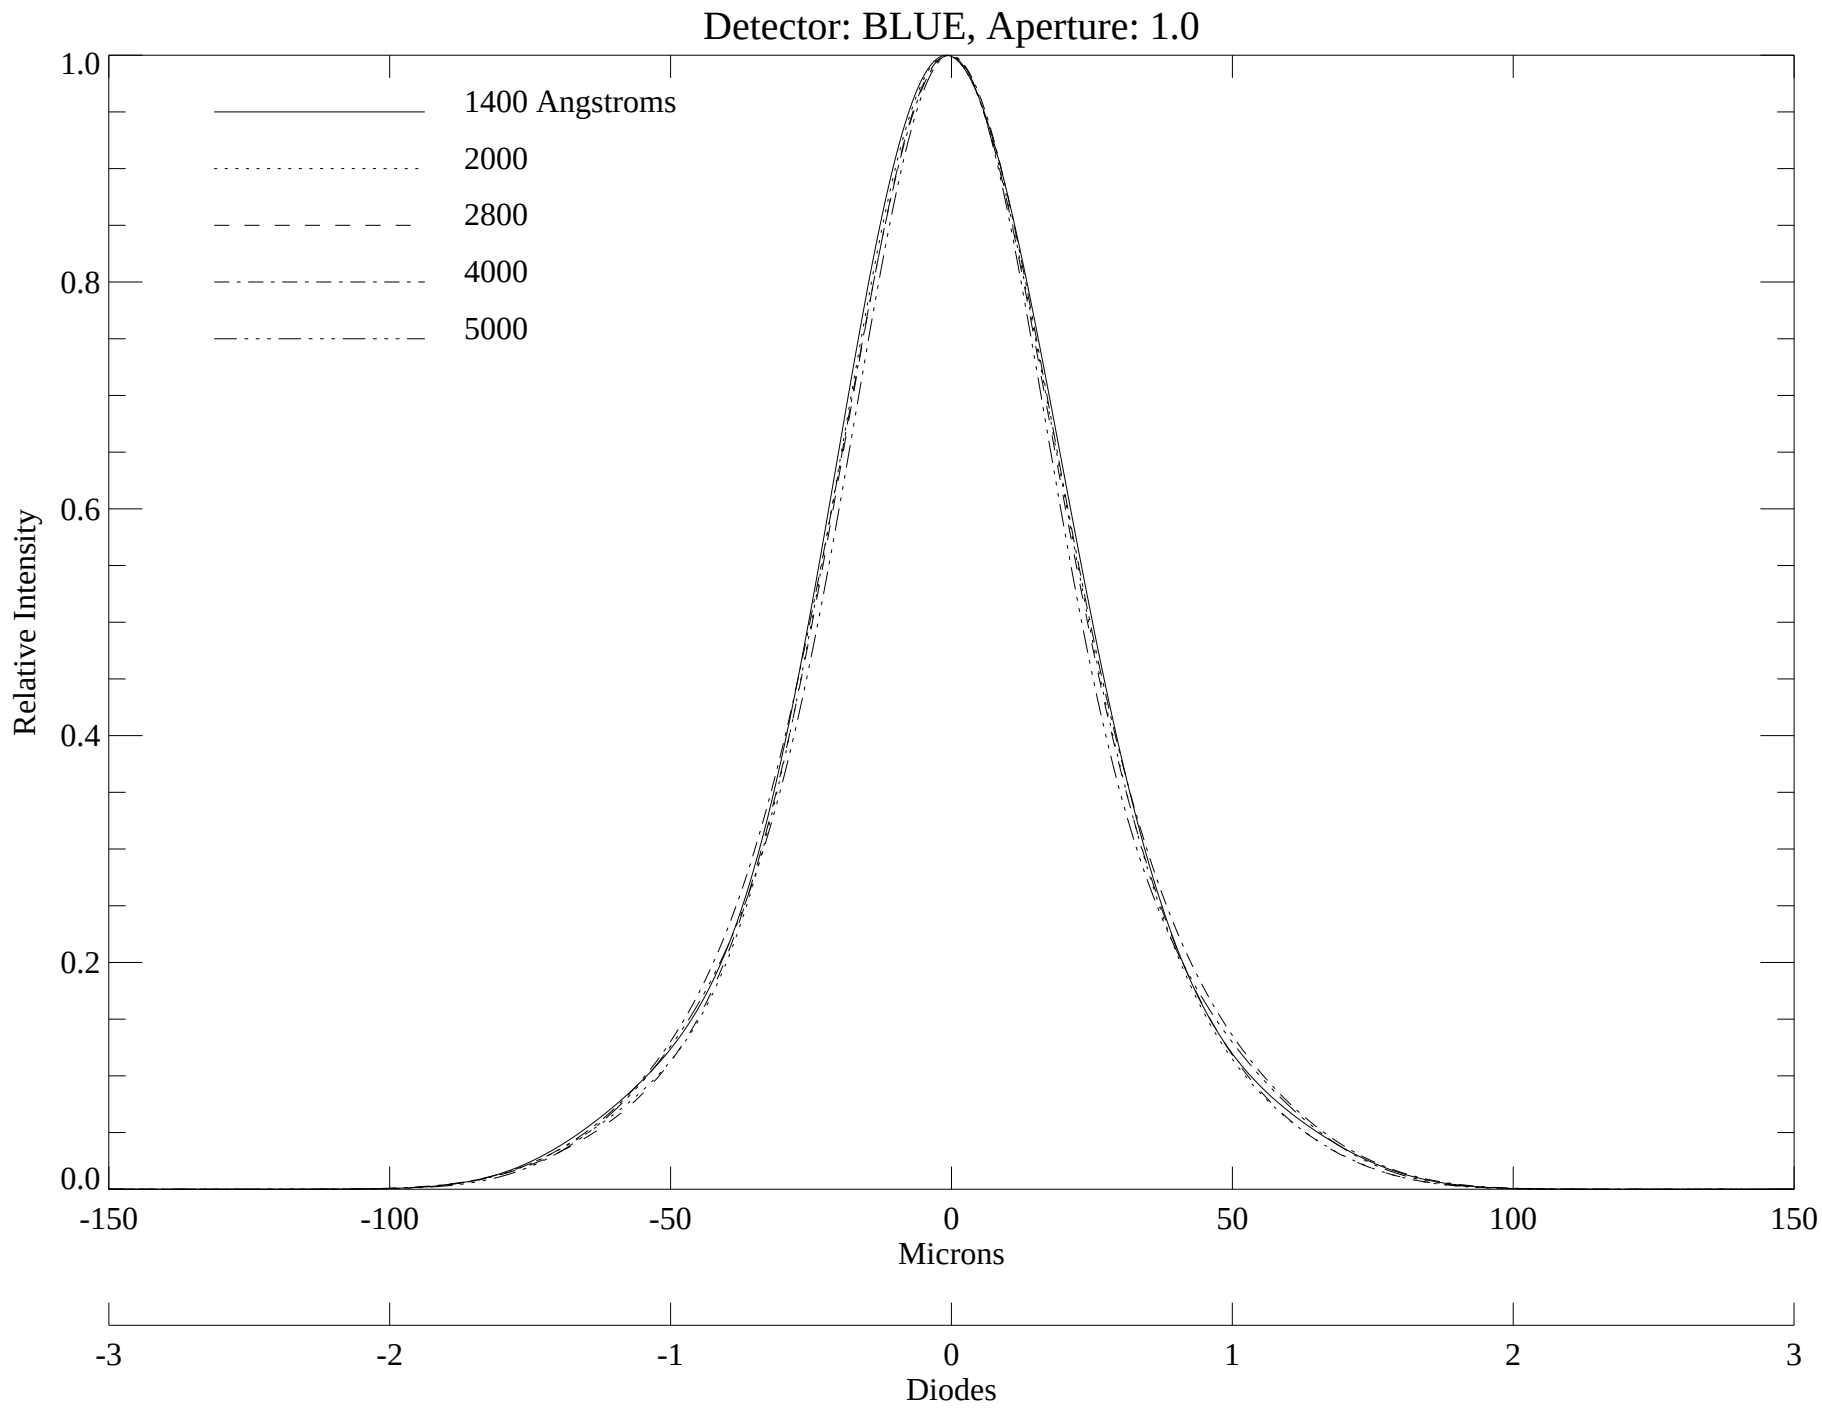
Detector: BLUE, Aperture: 1.0
1400 Angstroms
2000
2800
4000
5000
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-150
-100
-50
0
50
100
150
Microns
-3
-2
-1
0
1
2
3
Diodes

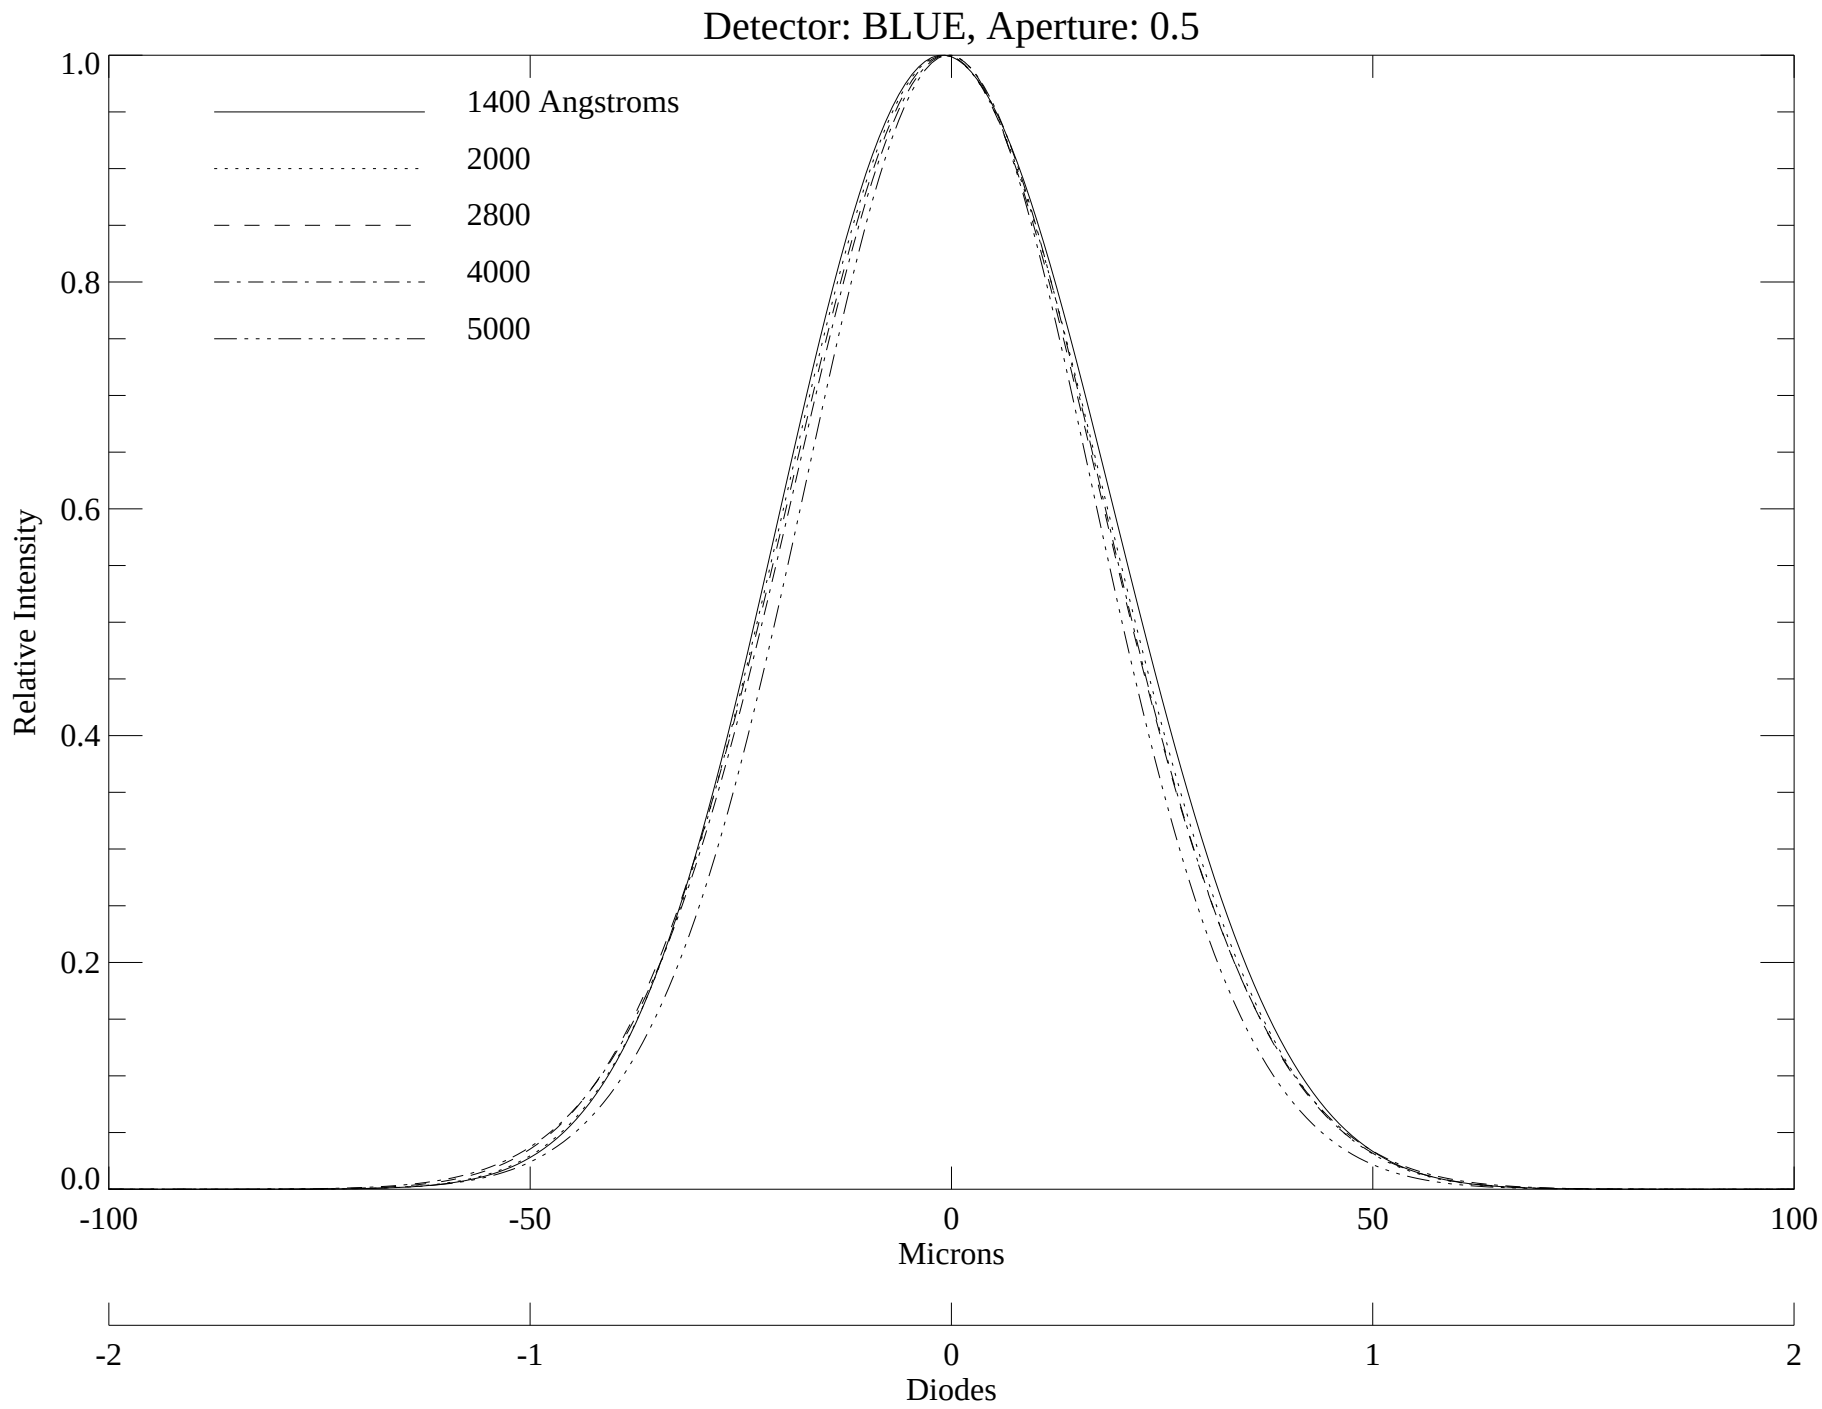
Detector: BLUE, Aperture: 0.5
1400 Angstroms
2000
2800
4000
5000
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-100
-50
0
50
100
Microns
-2
-1
0
1
2
Diodes

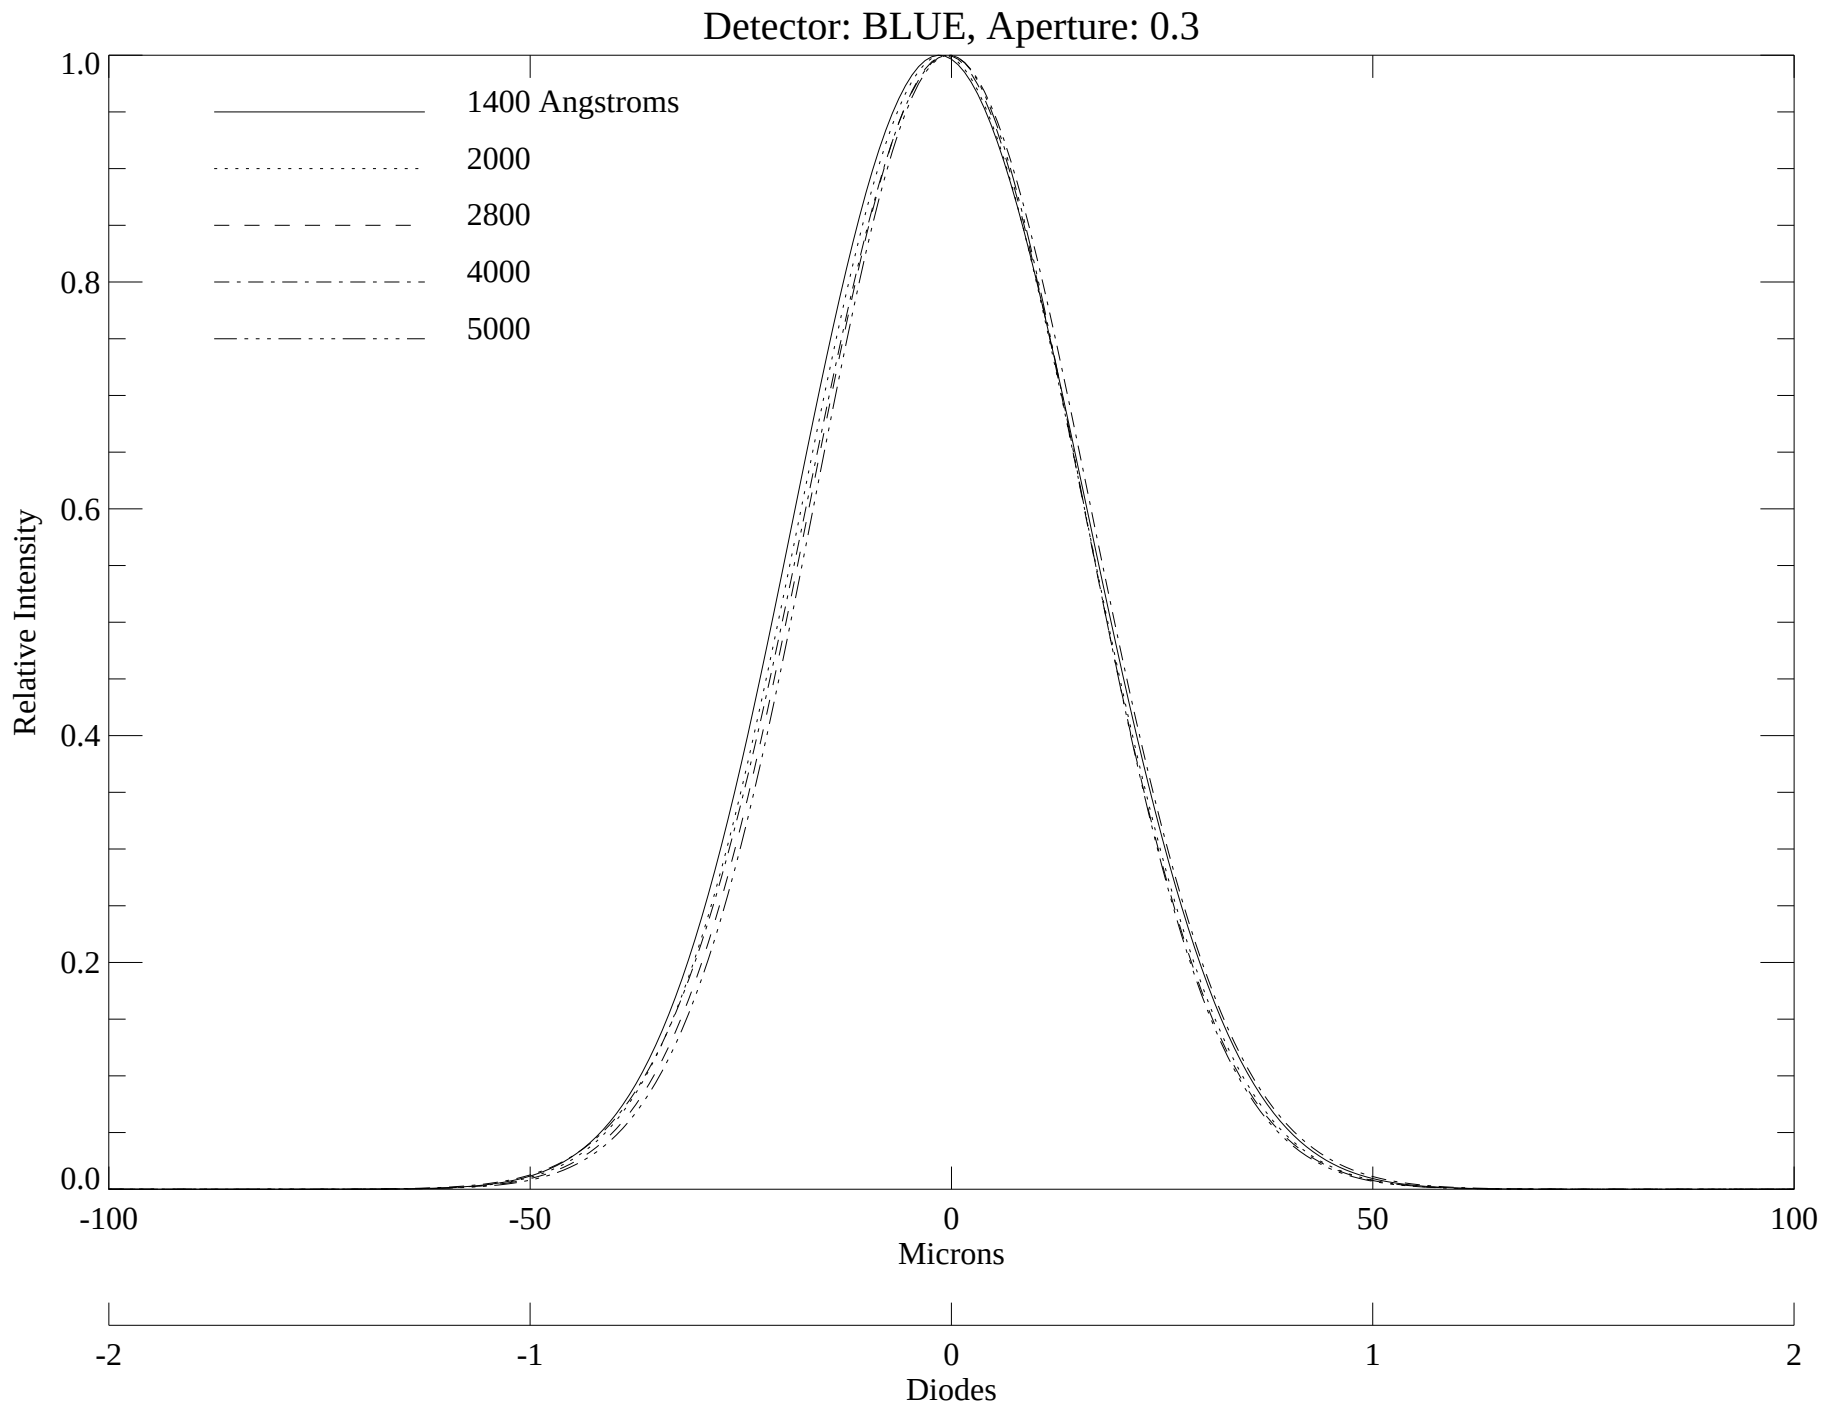
Detector: BLUE, Aperture: 0.3
1400 Angstroms
2000
2800
4000
5000
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-100
-50
0
50
100
Microns
-2
-1
0
1
2
Diodes

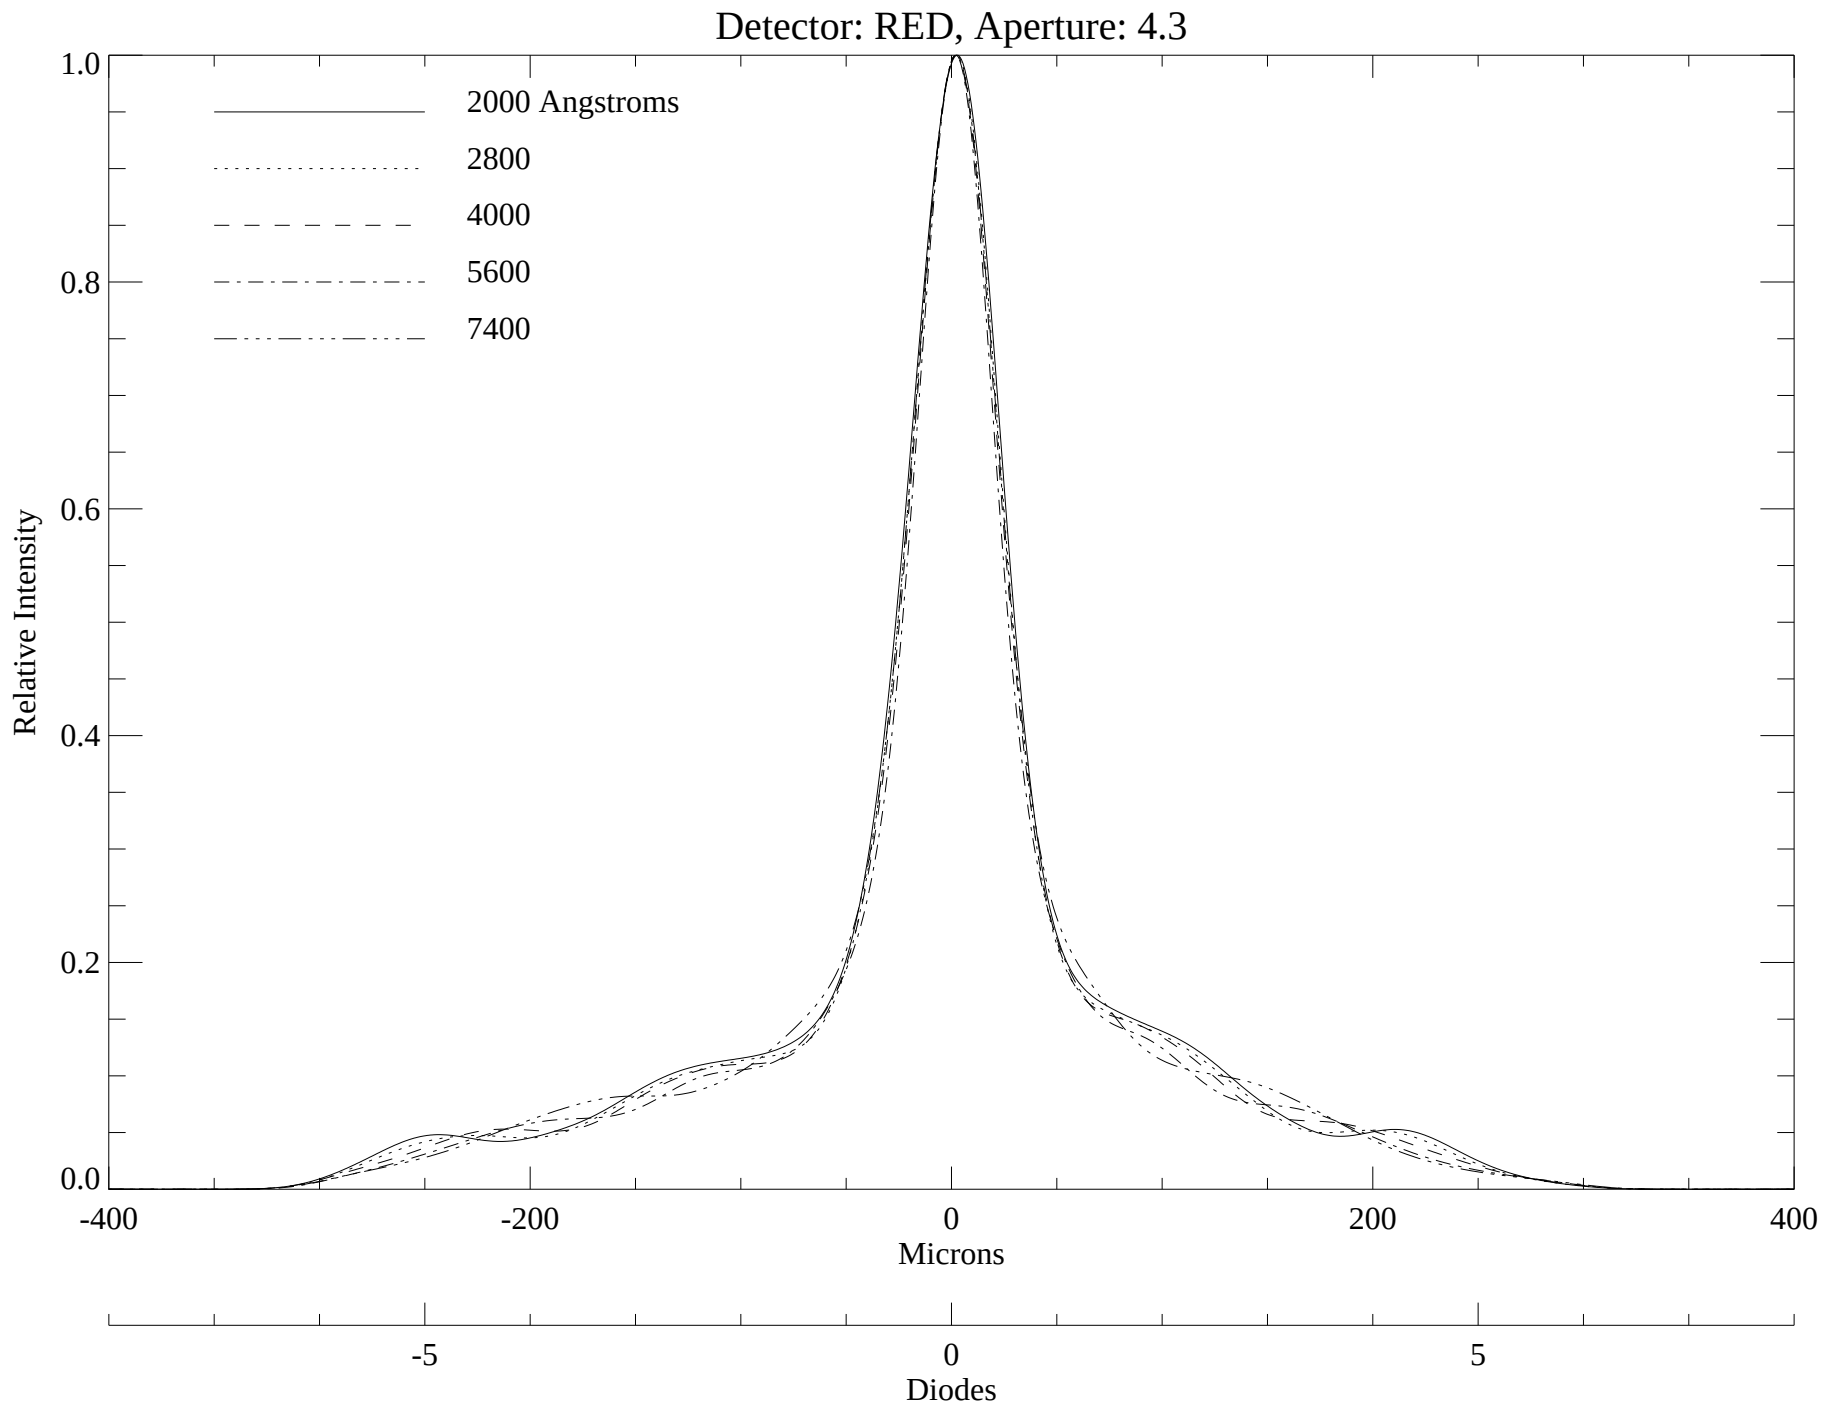
Detector: RED, Aperture: 4.3
2000 Angstroms
2800
4000
5600
7400
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-400
-200
0
200
400
Microns
-5
0
5
Diodes

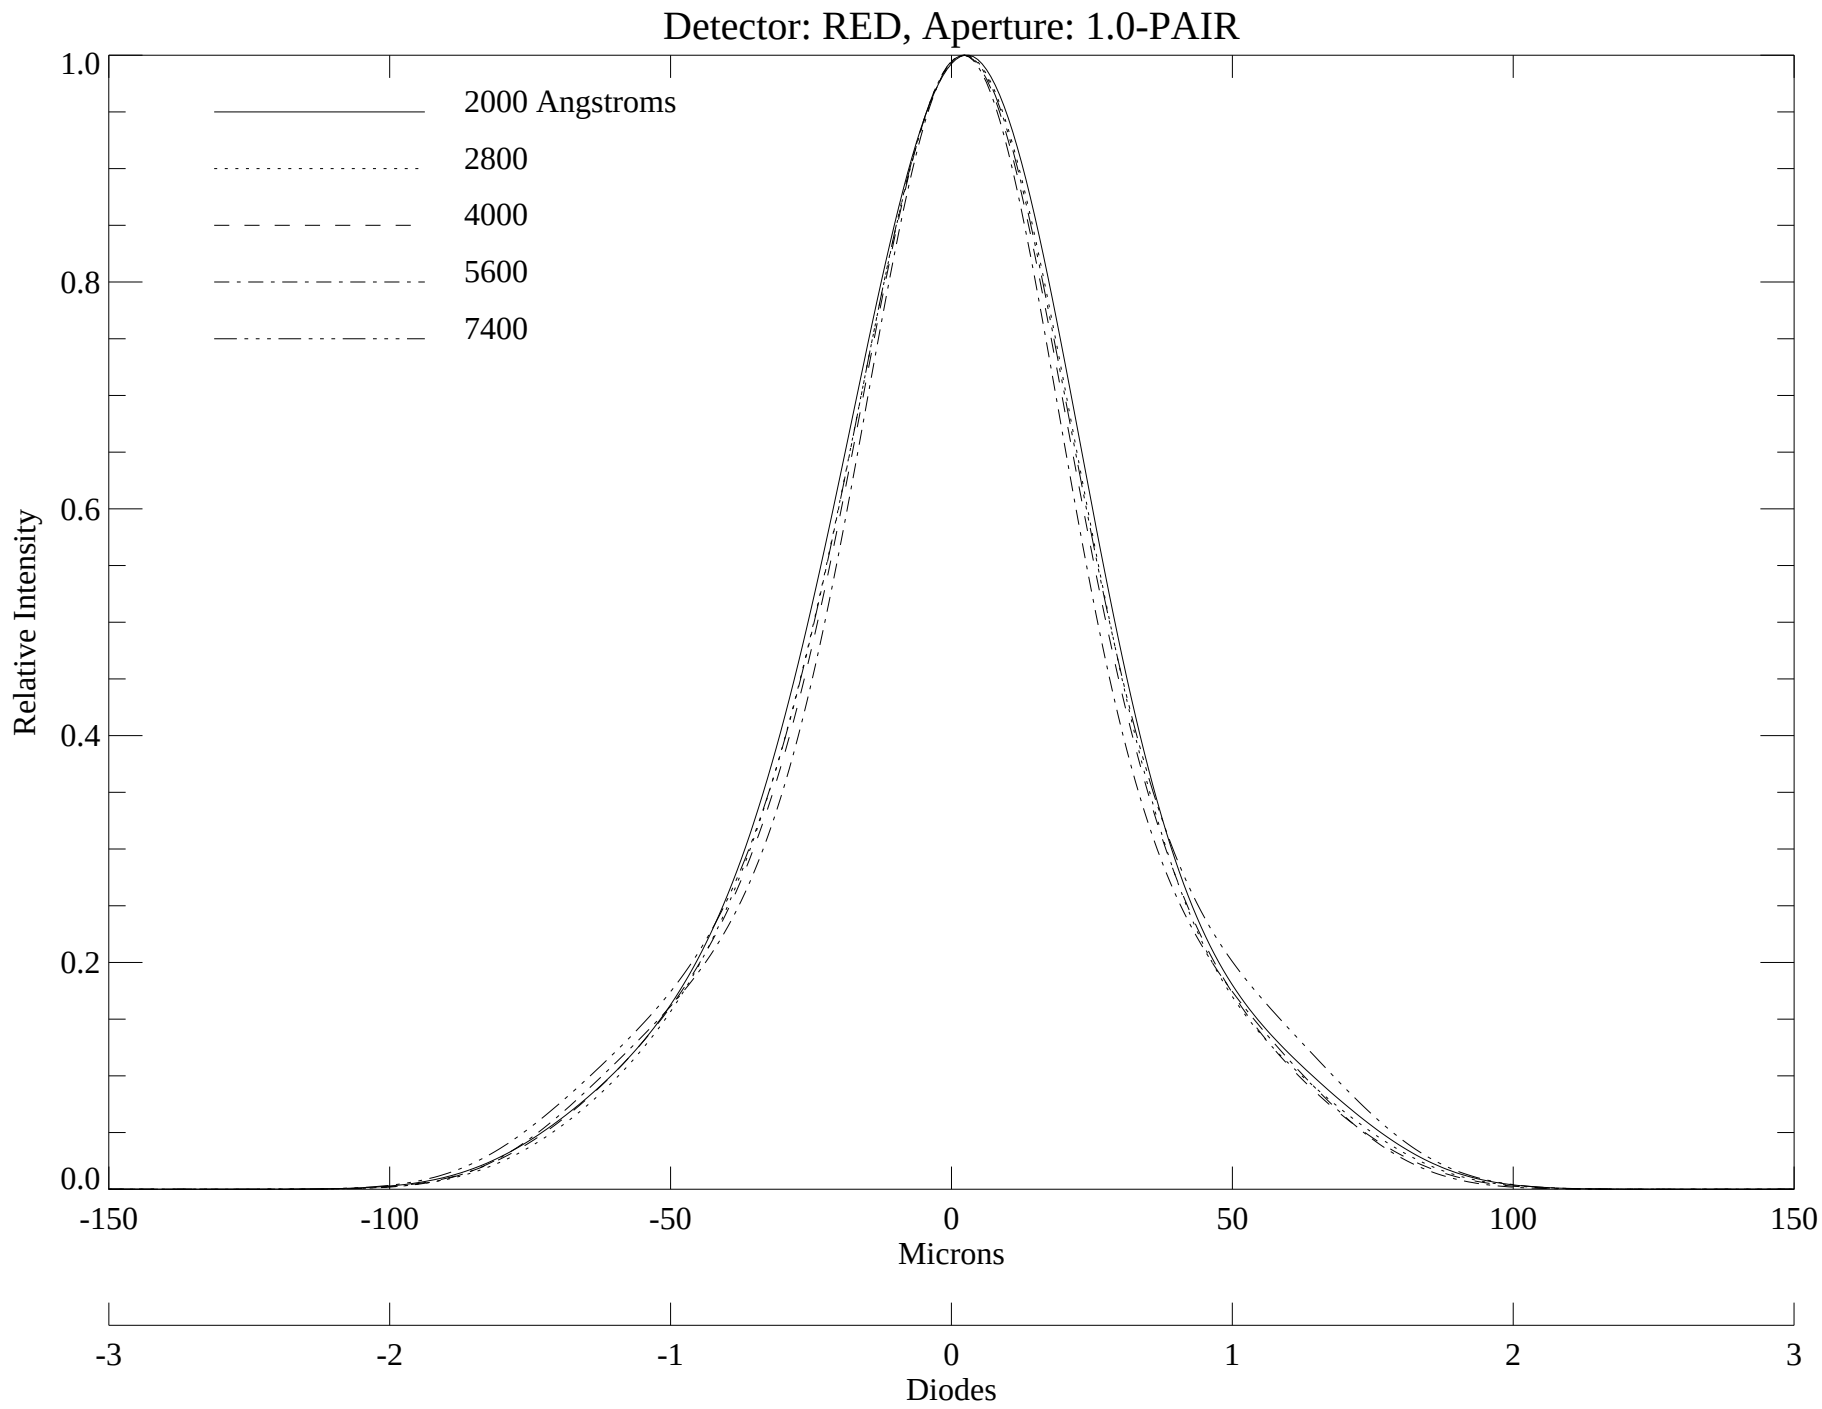
Detector: RED, Aperture: 1.0-PAIR
2000 Angstroms
2800
4000
5600
7400
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-150
-100
-50
0
50
100
150
Microns
-3
-2
-1
0
1
2
3
Diodes

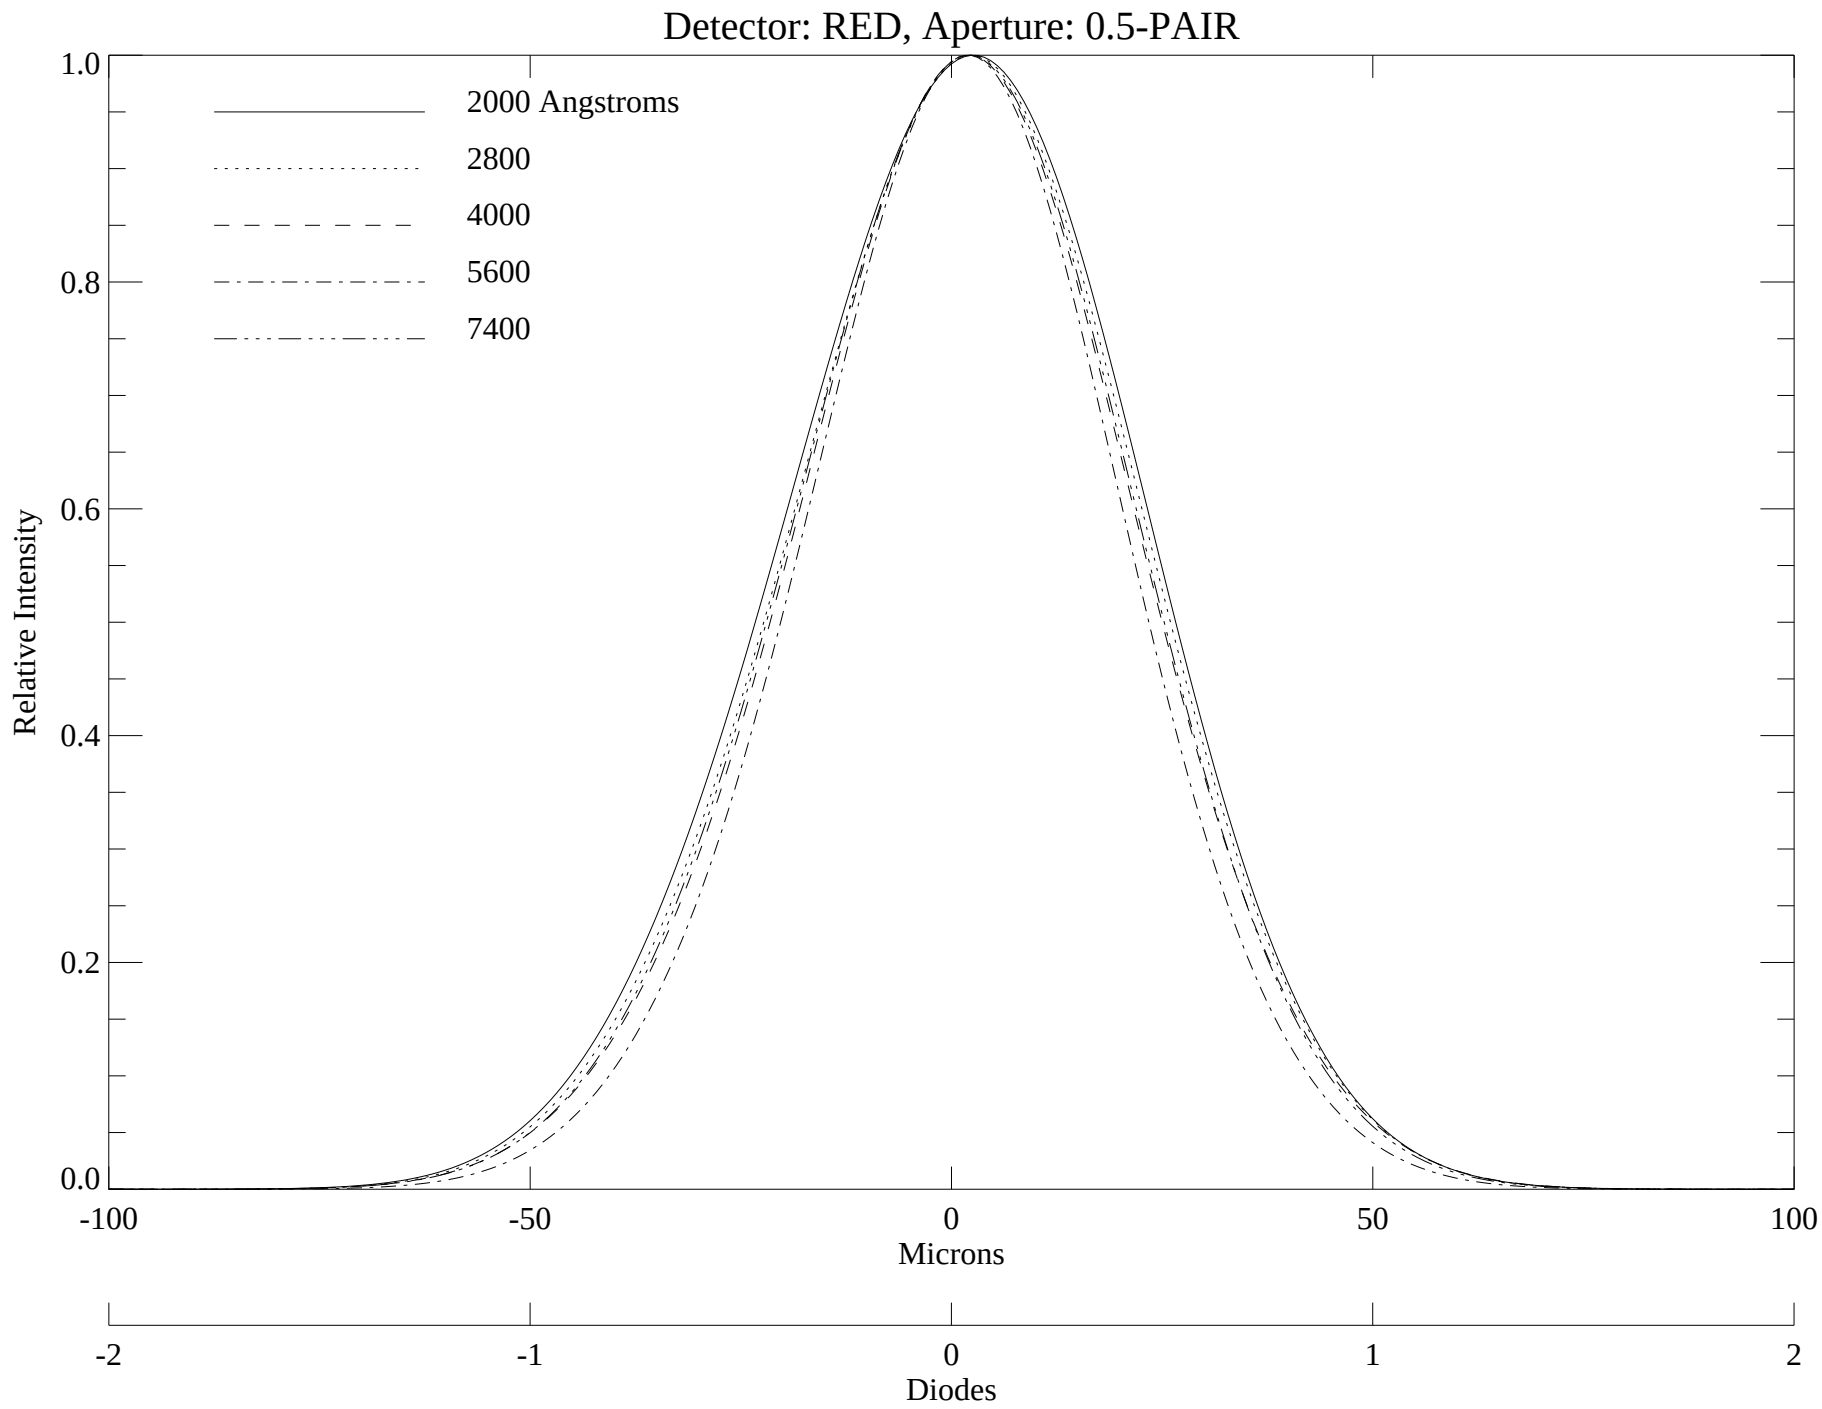
Detector: RED, Aperture: 0.5-PAIR
2000 Angstroms
2800
4000
5600
7400
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-100
-50
0
50
100
Microns
-2
-1
0
1
2
Diodes

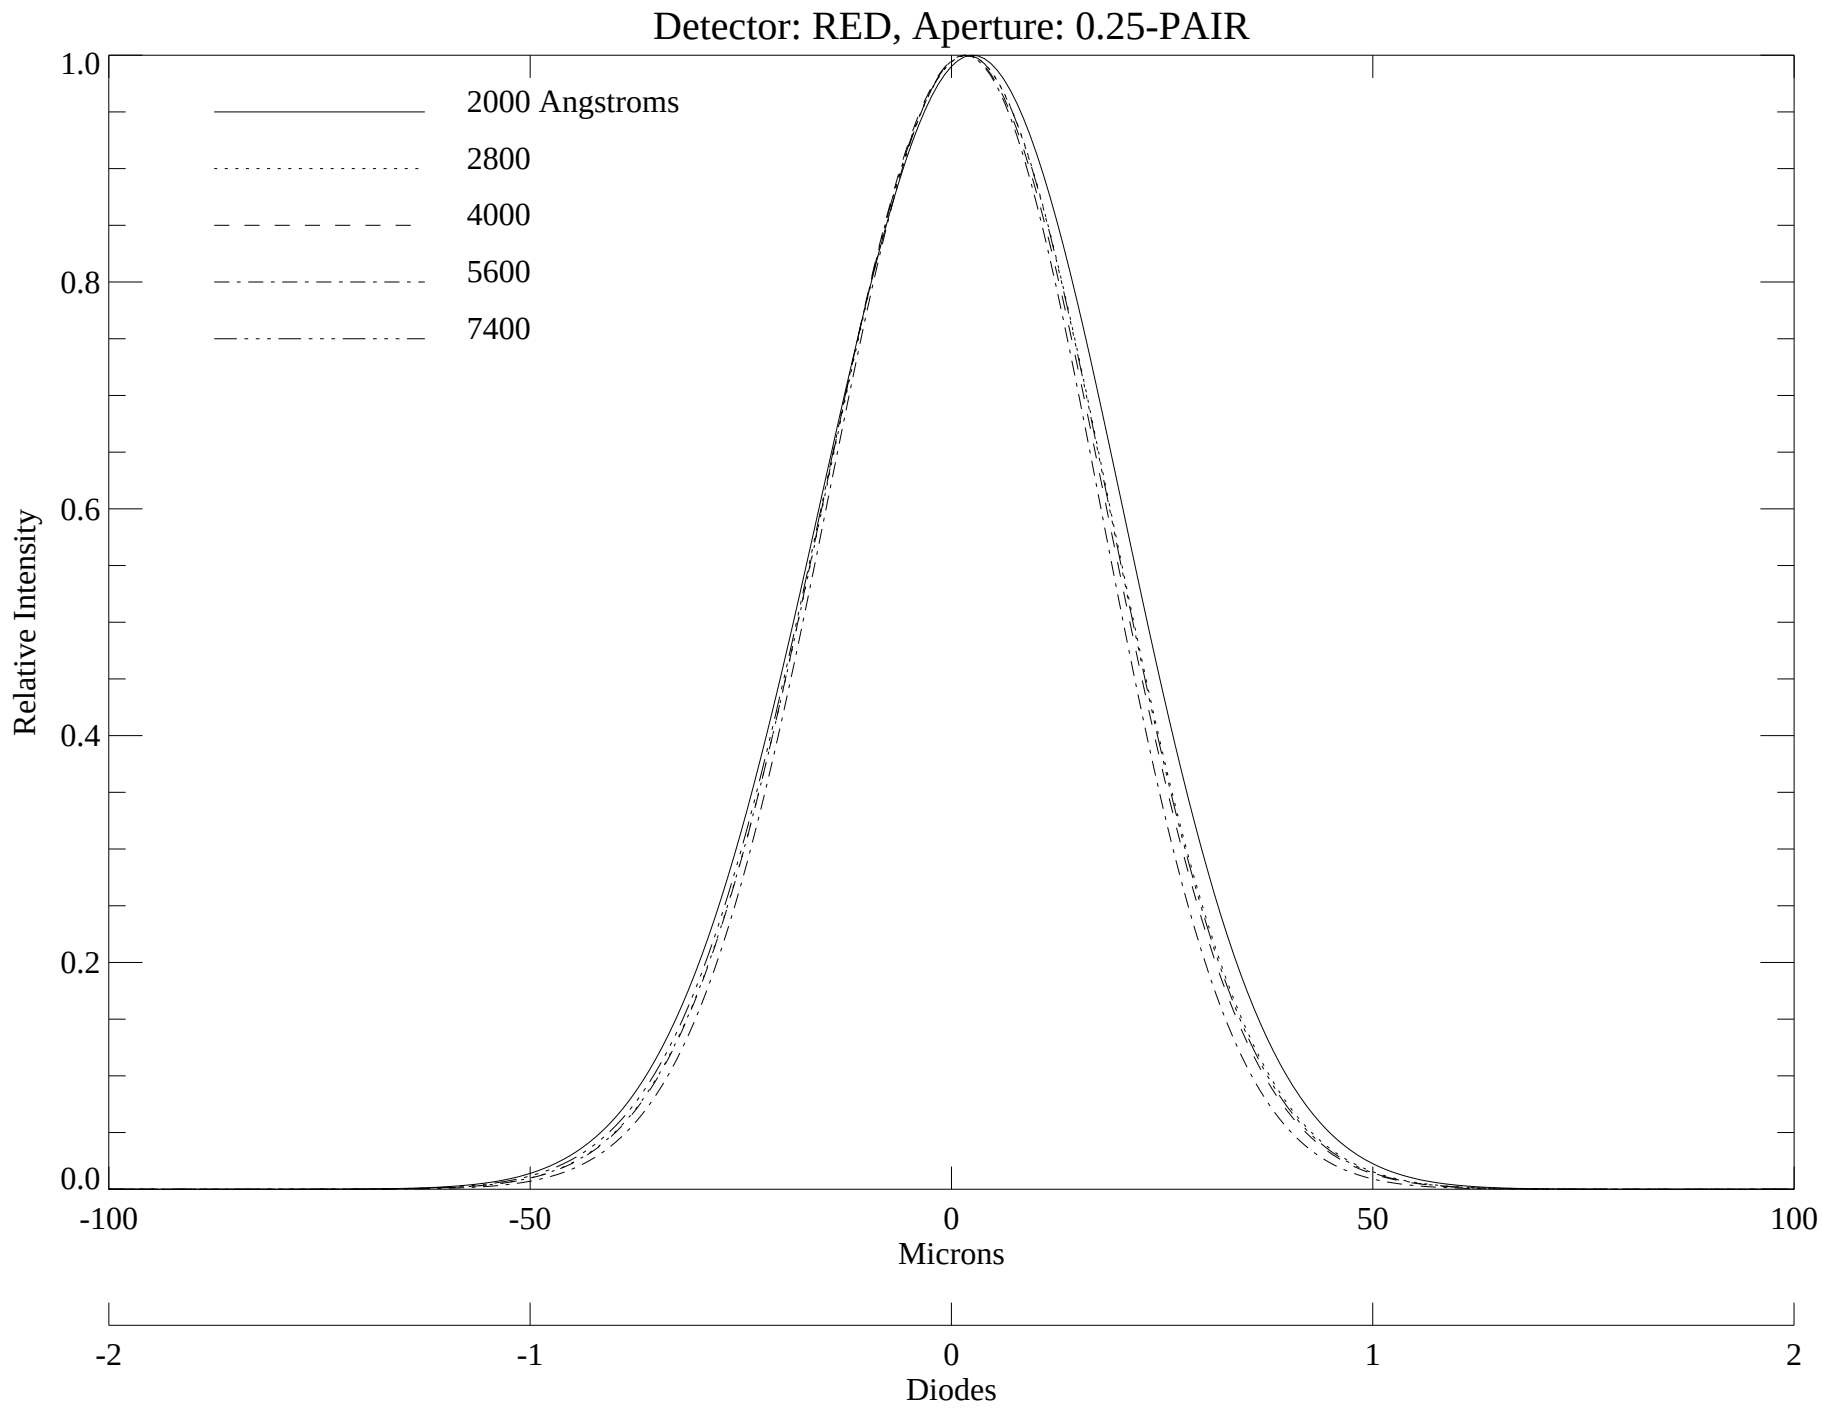
Detector: RED, Aperture: 0.25-PAIR
2000 Angstroms
2800
4000
5600
7400
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-100
-50
0
50
100
Microns
-2
-1
0
1
2
Diodes

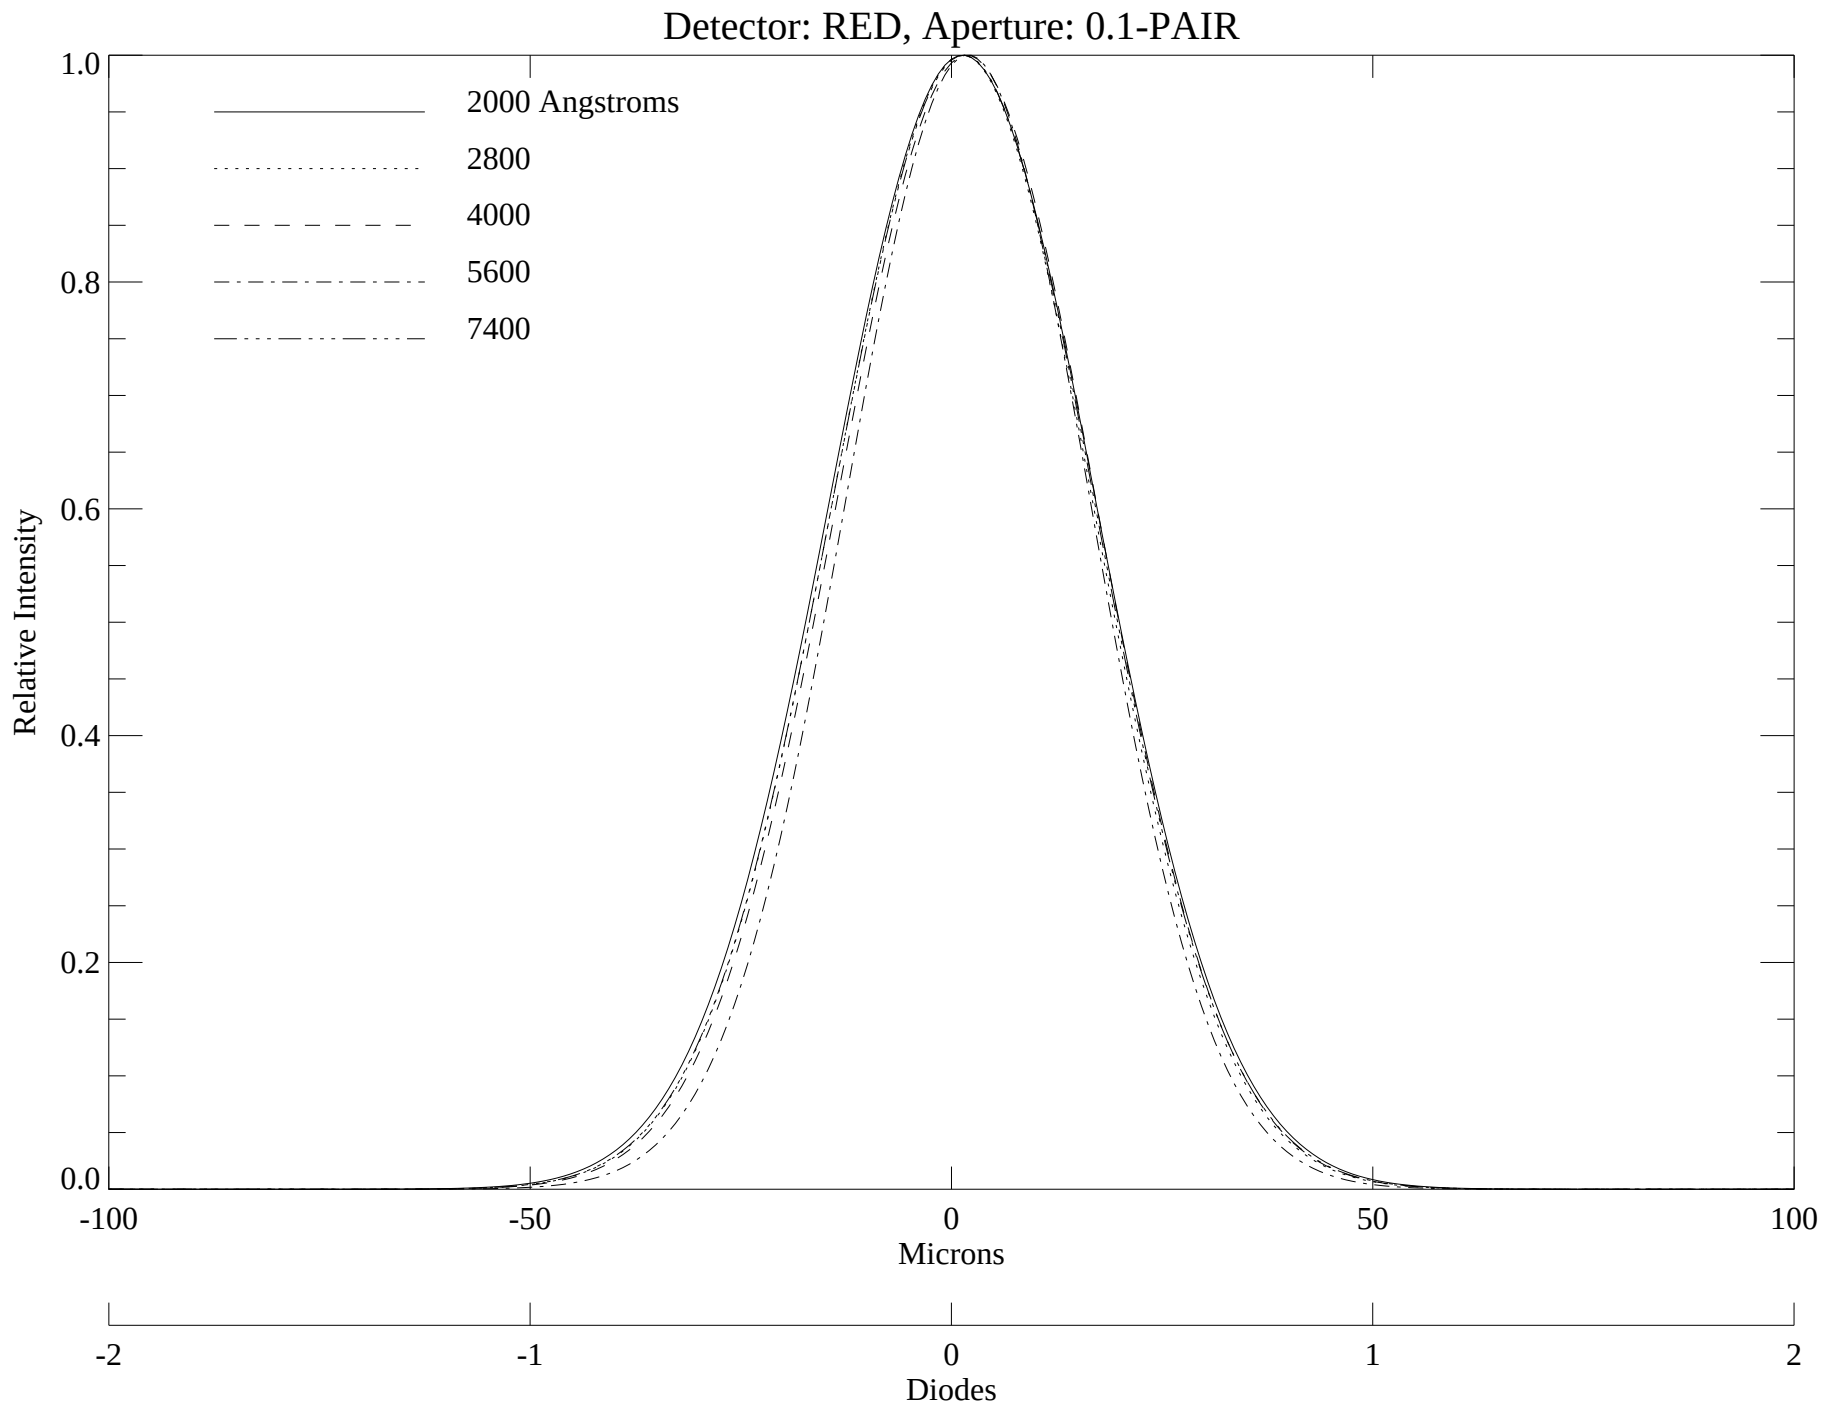
Detector: RED, Aperture: 0.1-PAIR
2000 Angstroms
2800
4000
5600
7400
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-100
-50
0
50
100
Microns
-2
-1
0
1
2
Diodes

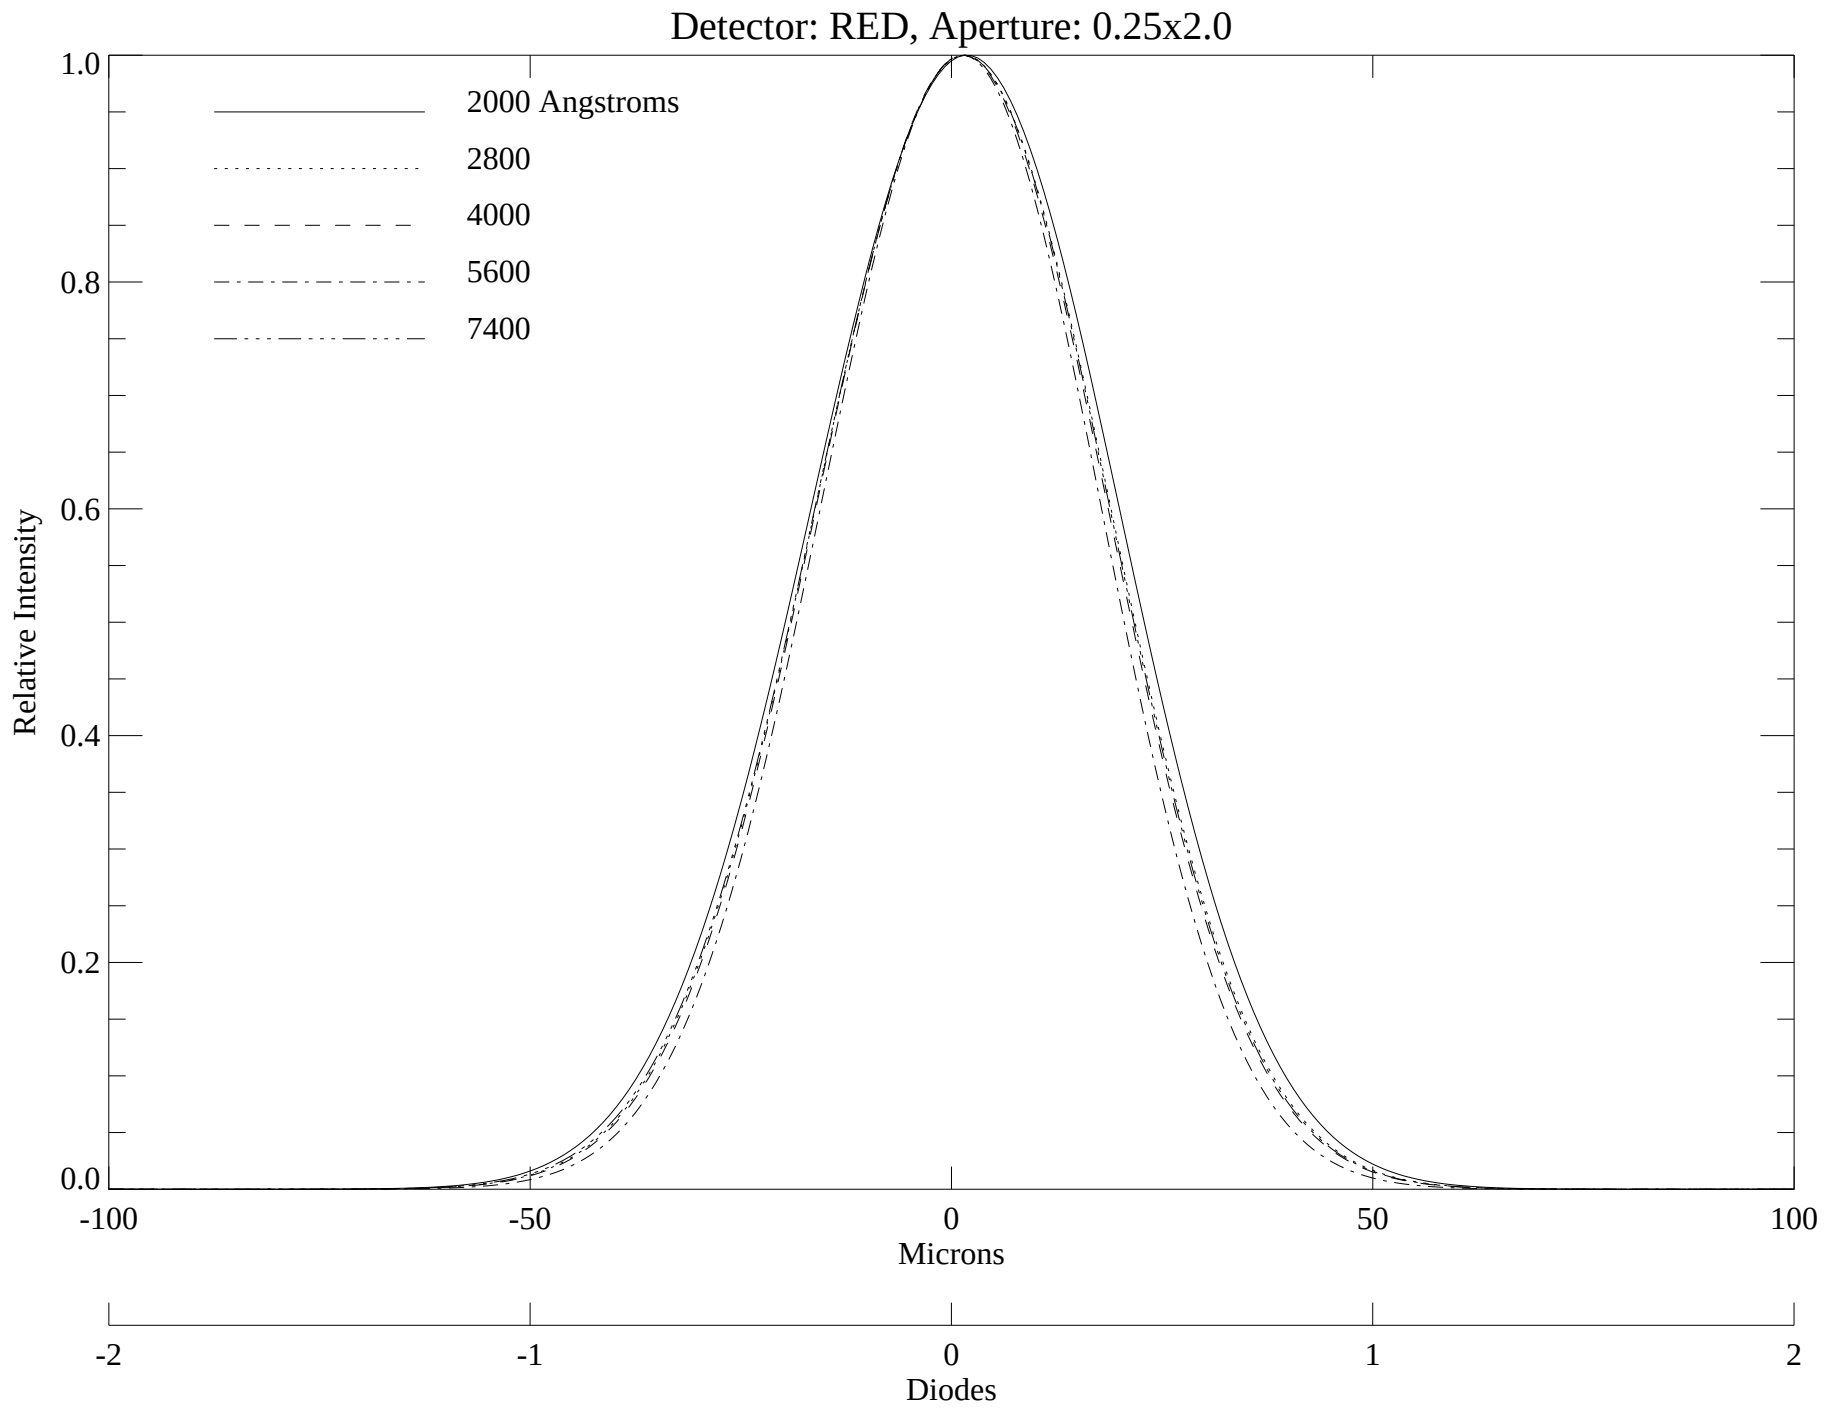
Detector: RED, Aperture: 0.25x2.0
2000 Angstroms
2800
4000
5600
7400
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-100
-50
0
50
100
Microns
-2
-1
0
1
2
Diodes

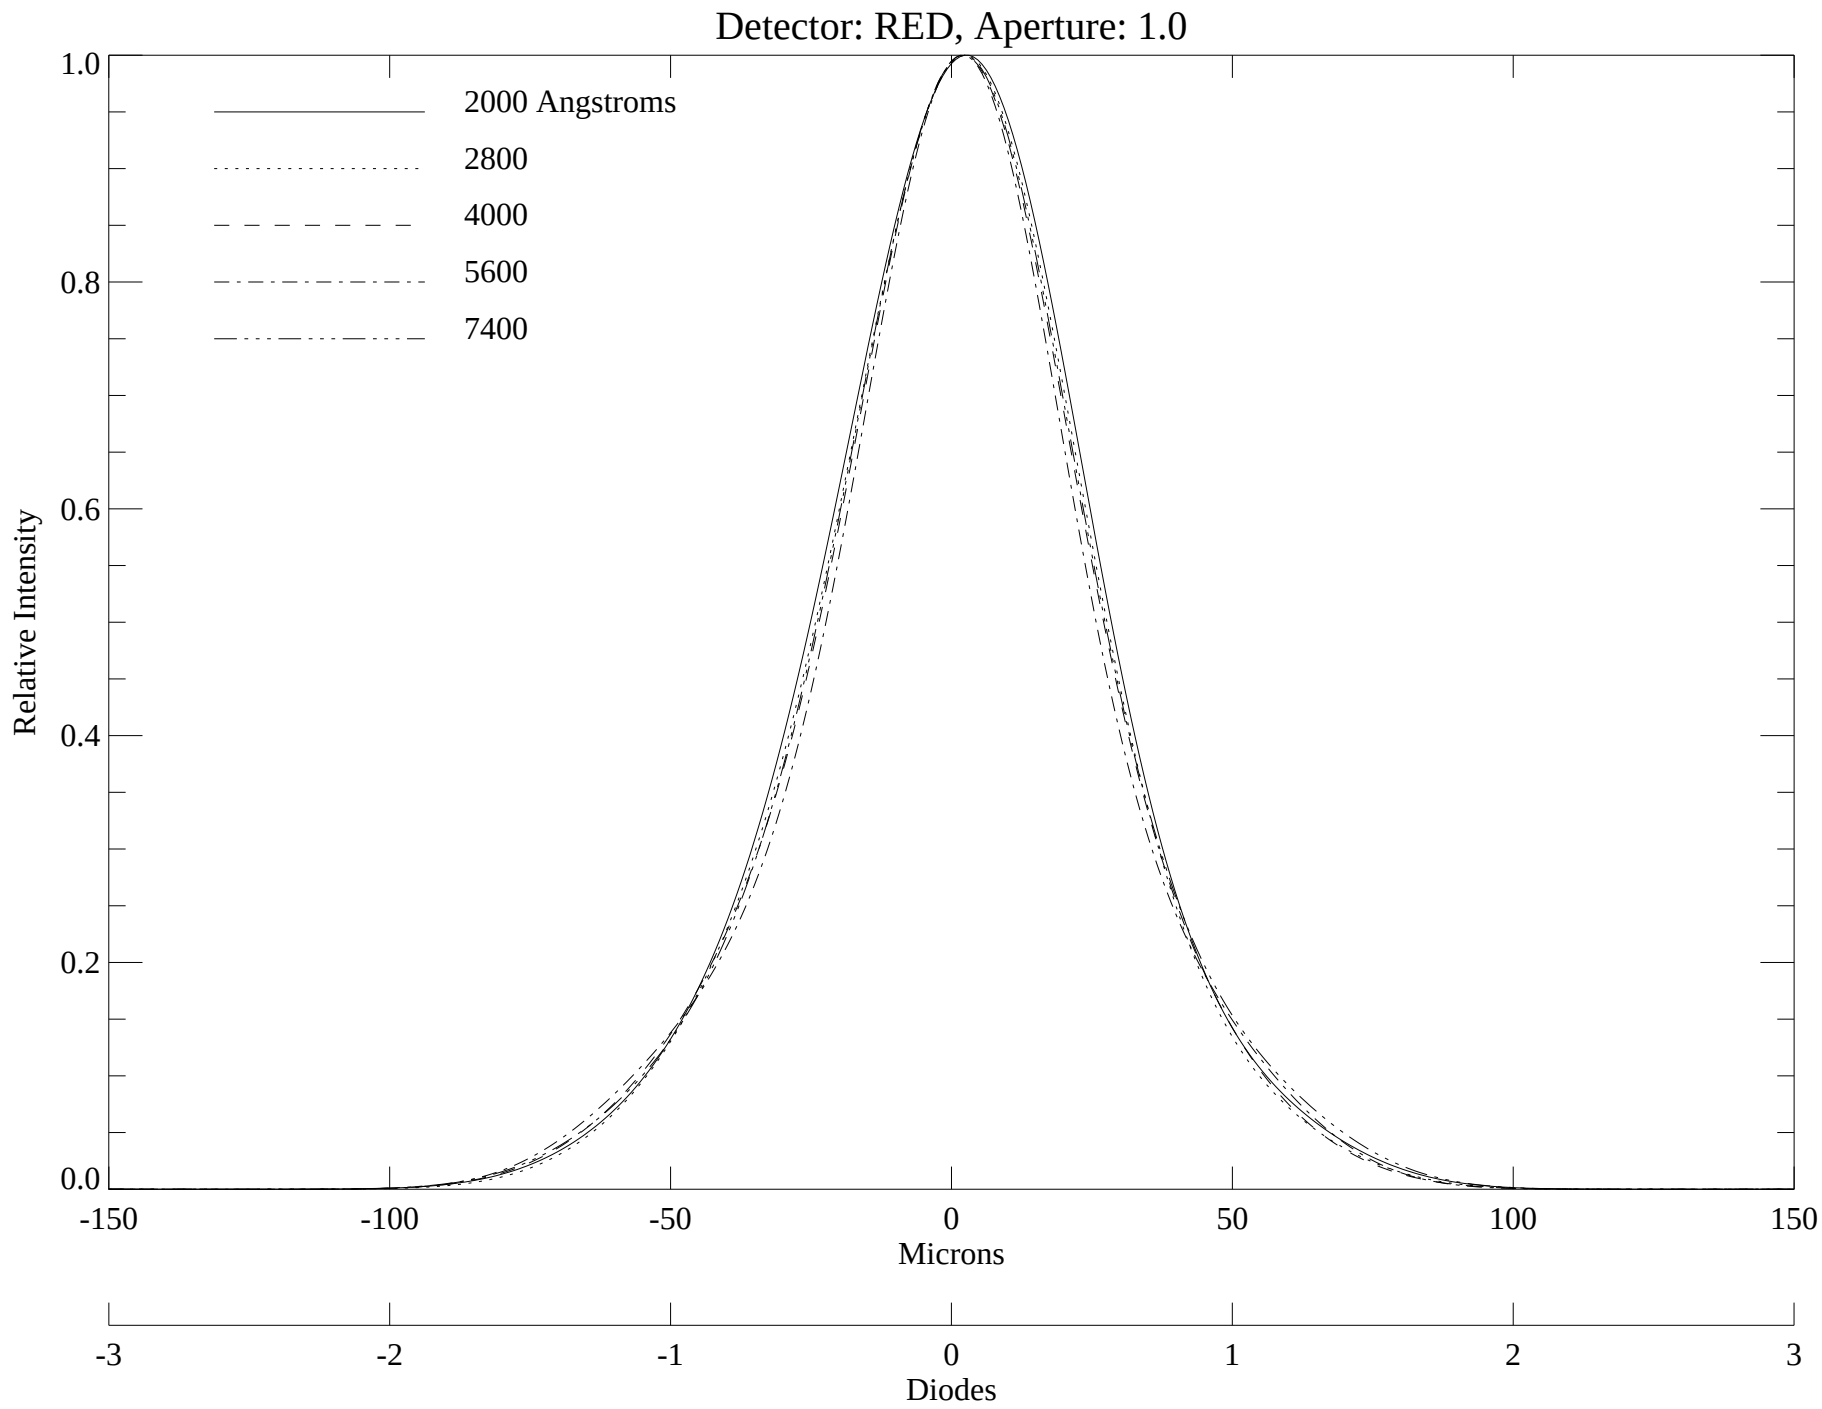
Detector: RED, Aperture: 1.0
2000 Angstroms
2800
4000
5600
7400
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-150
-100
-50
0
50
100
150
Microns
-3
-2
-1
0
1
2
3
Diodes

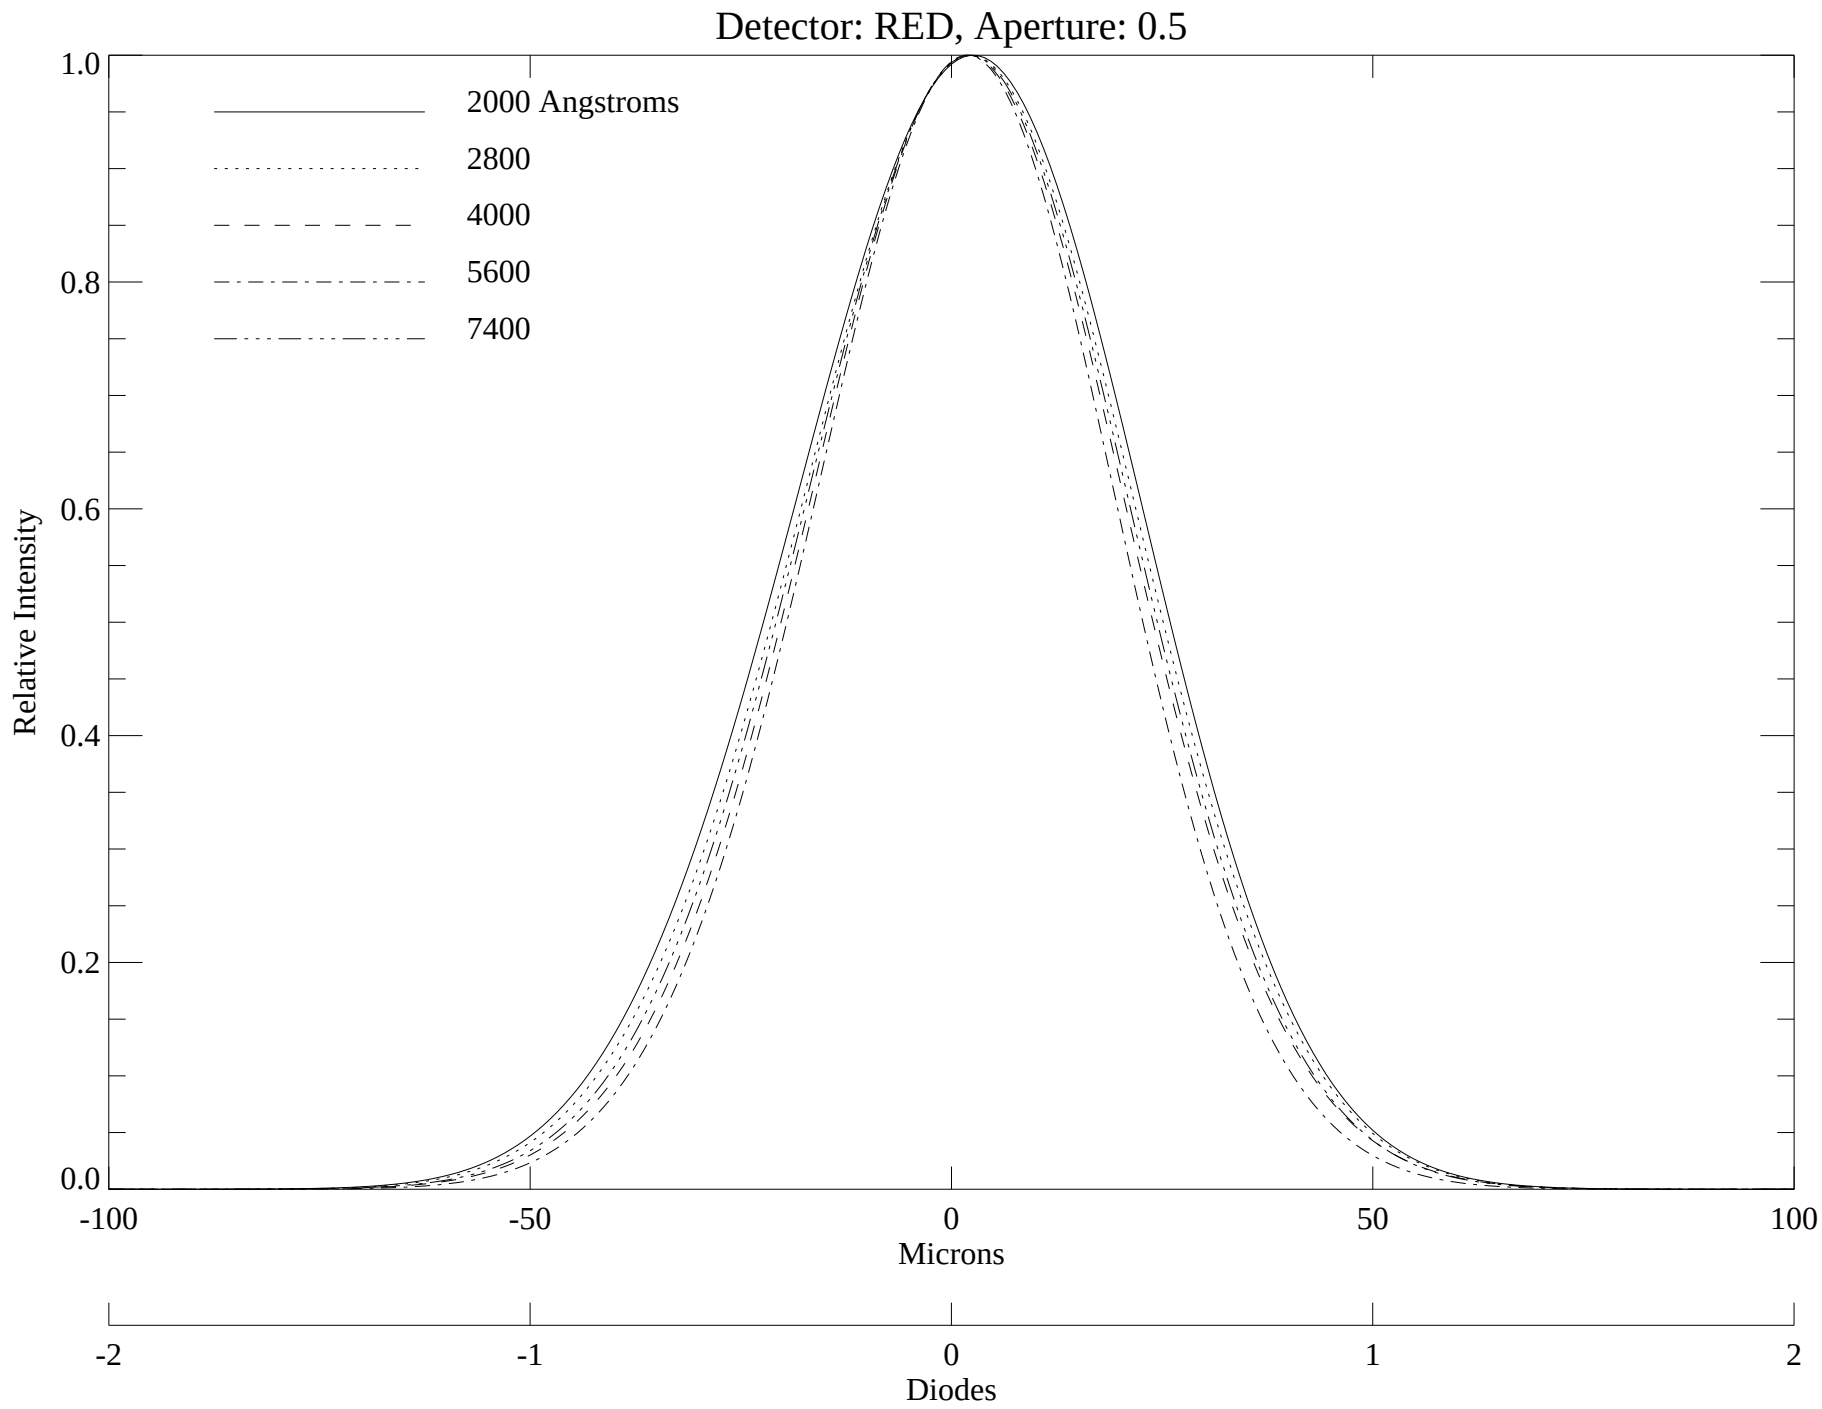
Detector: RED, Aperture: 0.5
2000 Angstroms
2800
4000
5600
7400
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-100
-50
0
50
100
Microns
-2
-1
0
1
2
Diodes

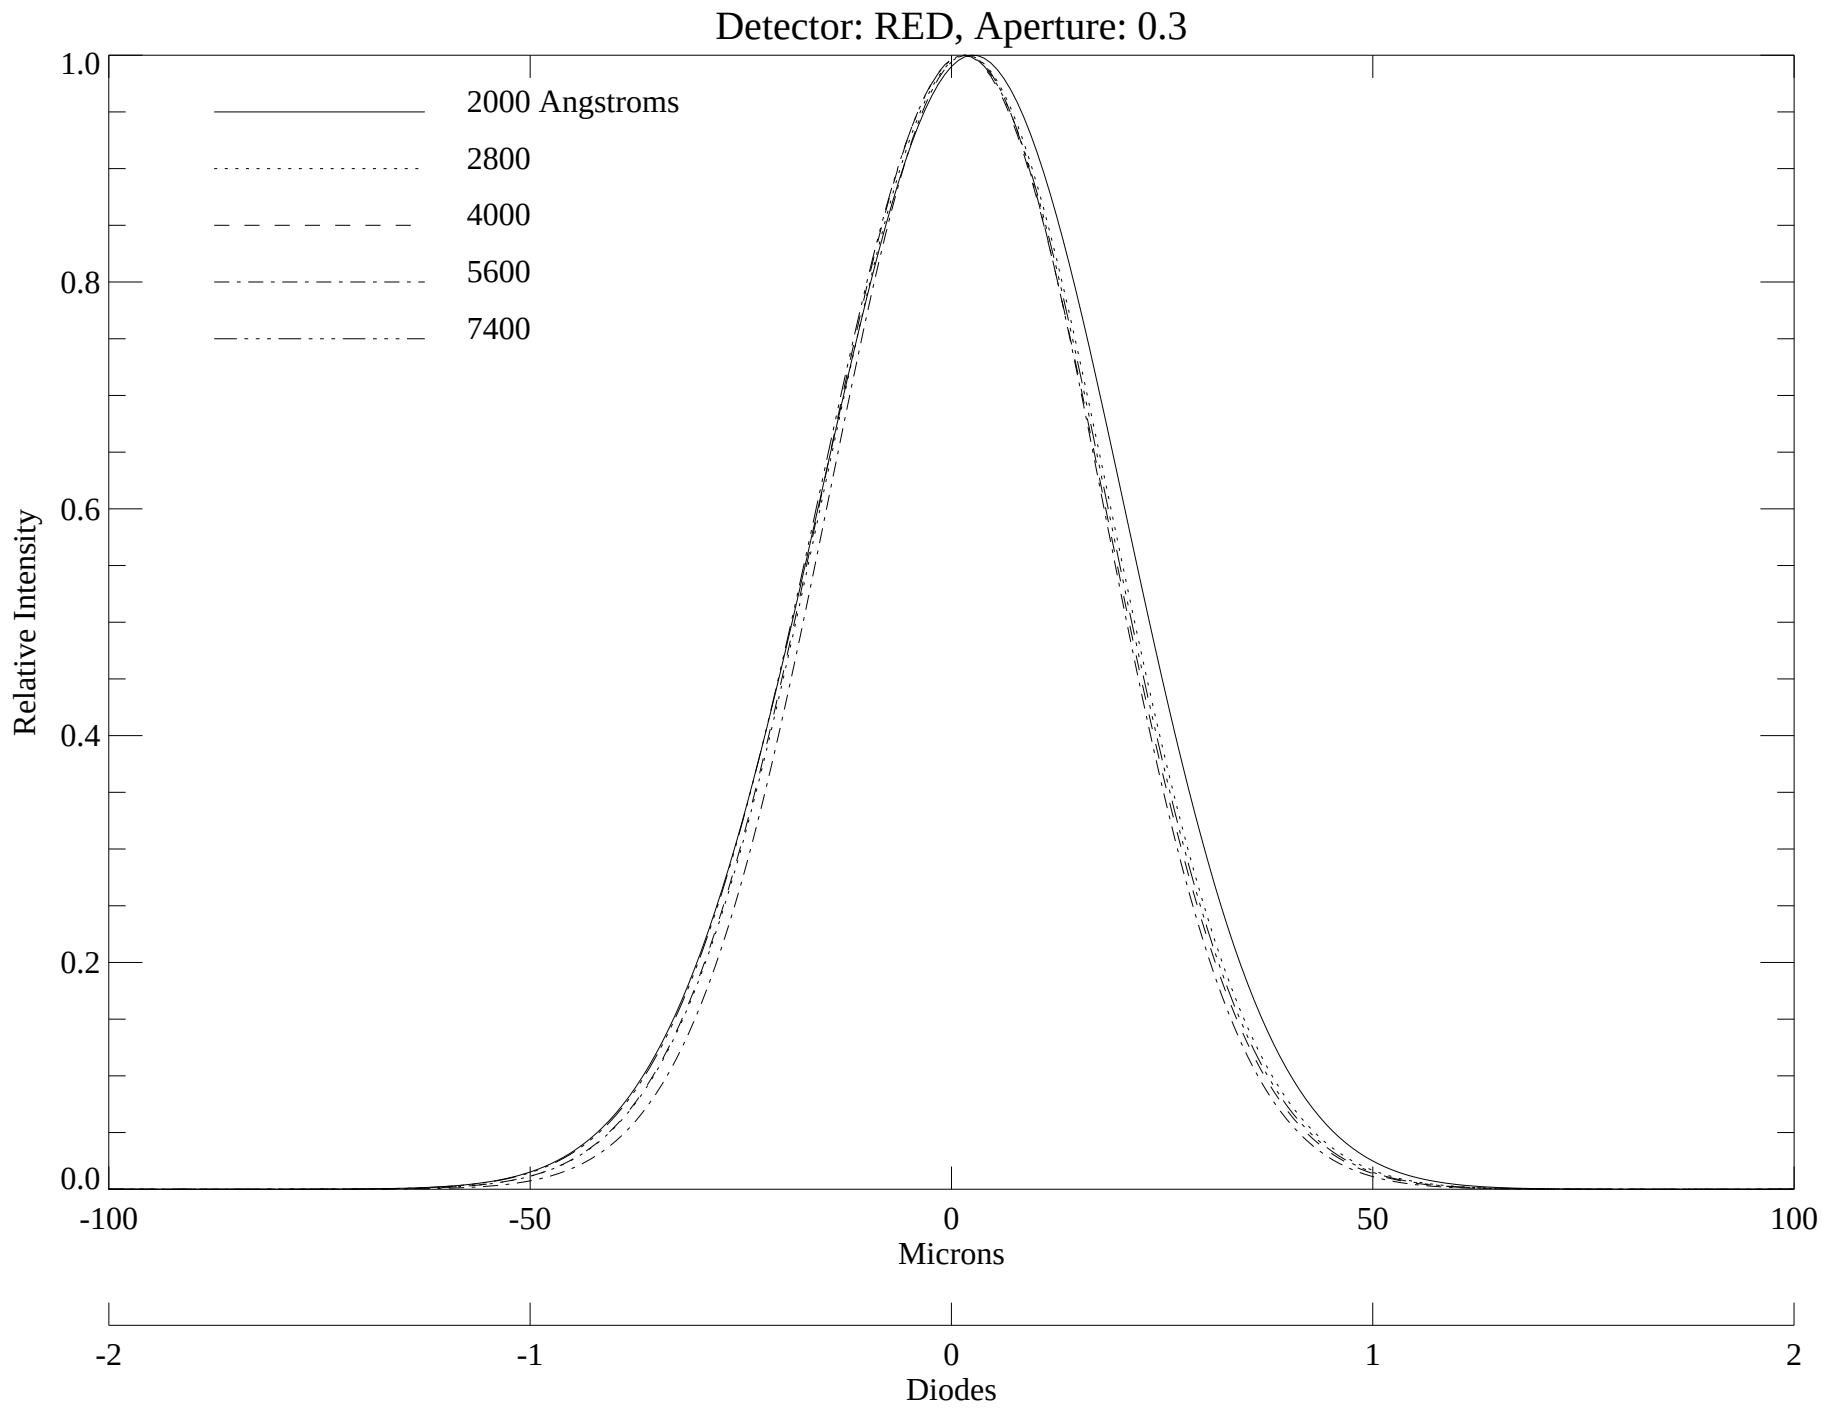
Detector: RED, Aperture: 0.3
2000 Angstroms
2800
4000
5600
7400
Relative Intensity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-100
-50
0
50
100
Microns
-2
-1
0
1
2
Diodes